




(別紙1) 手術室 清掃作業範囲

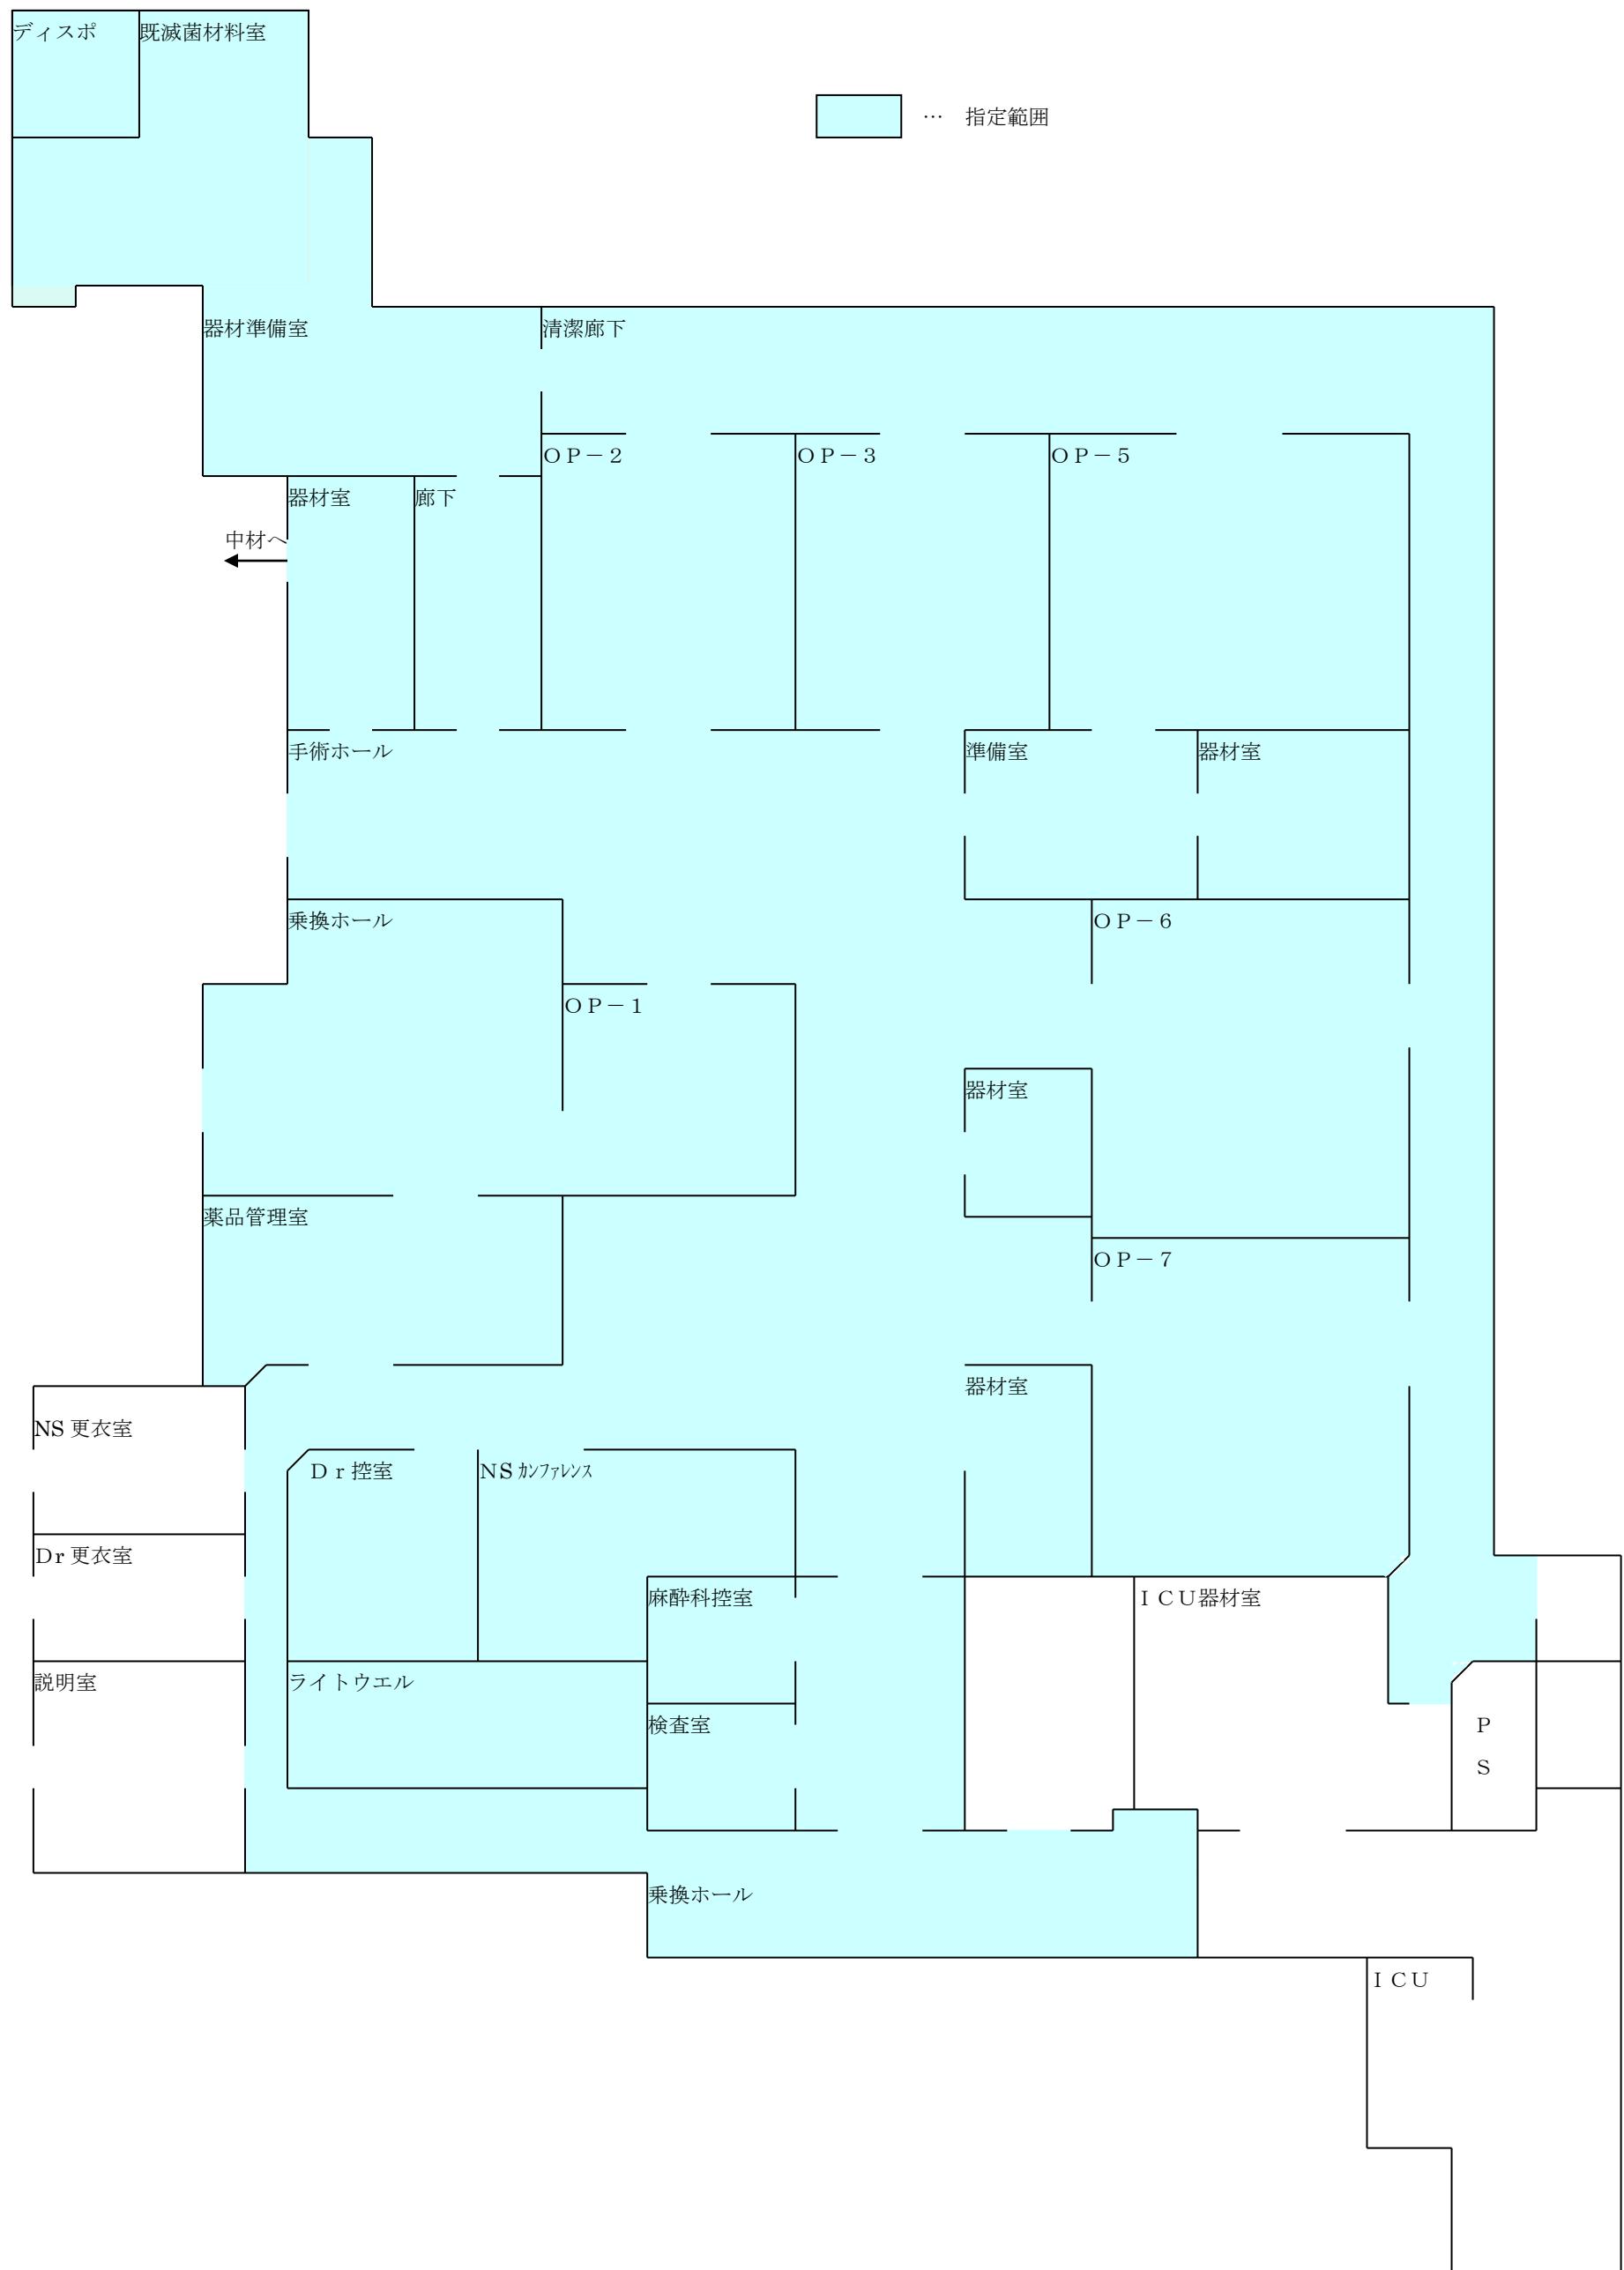


(別紙2) 手術室 床面ワックス処理作業範囲

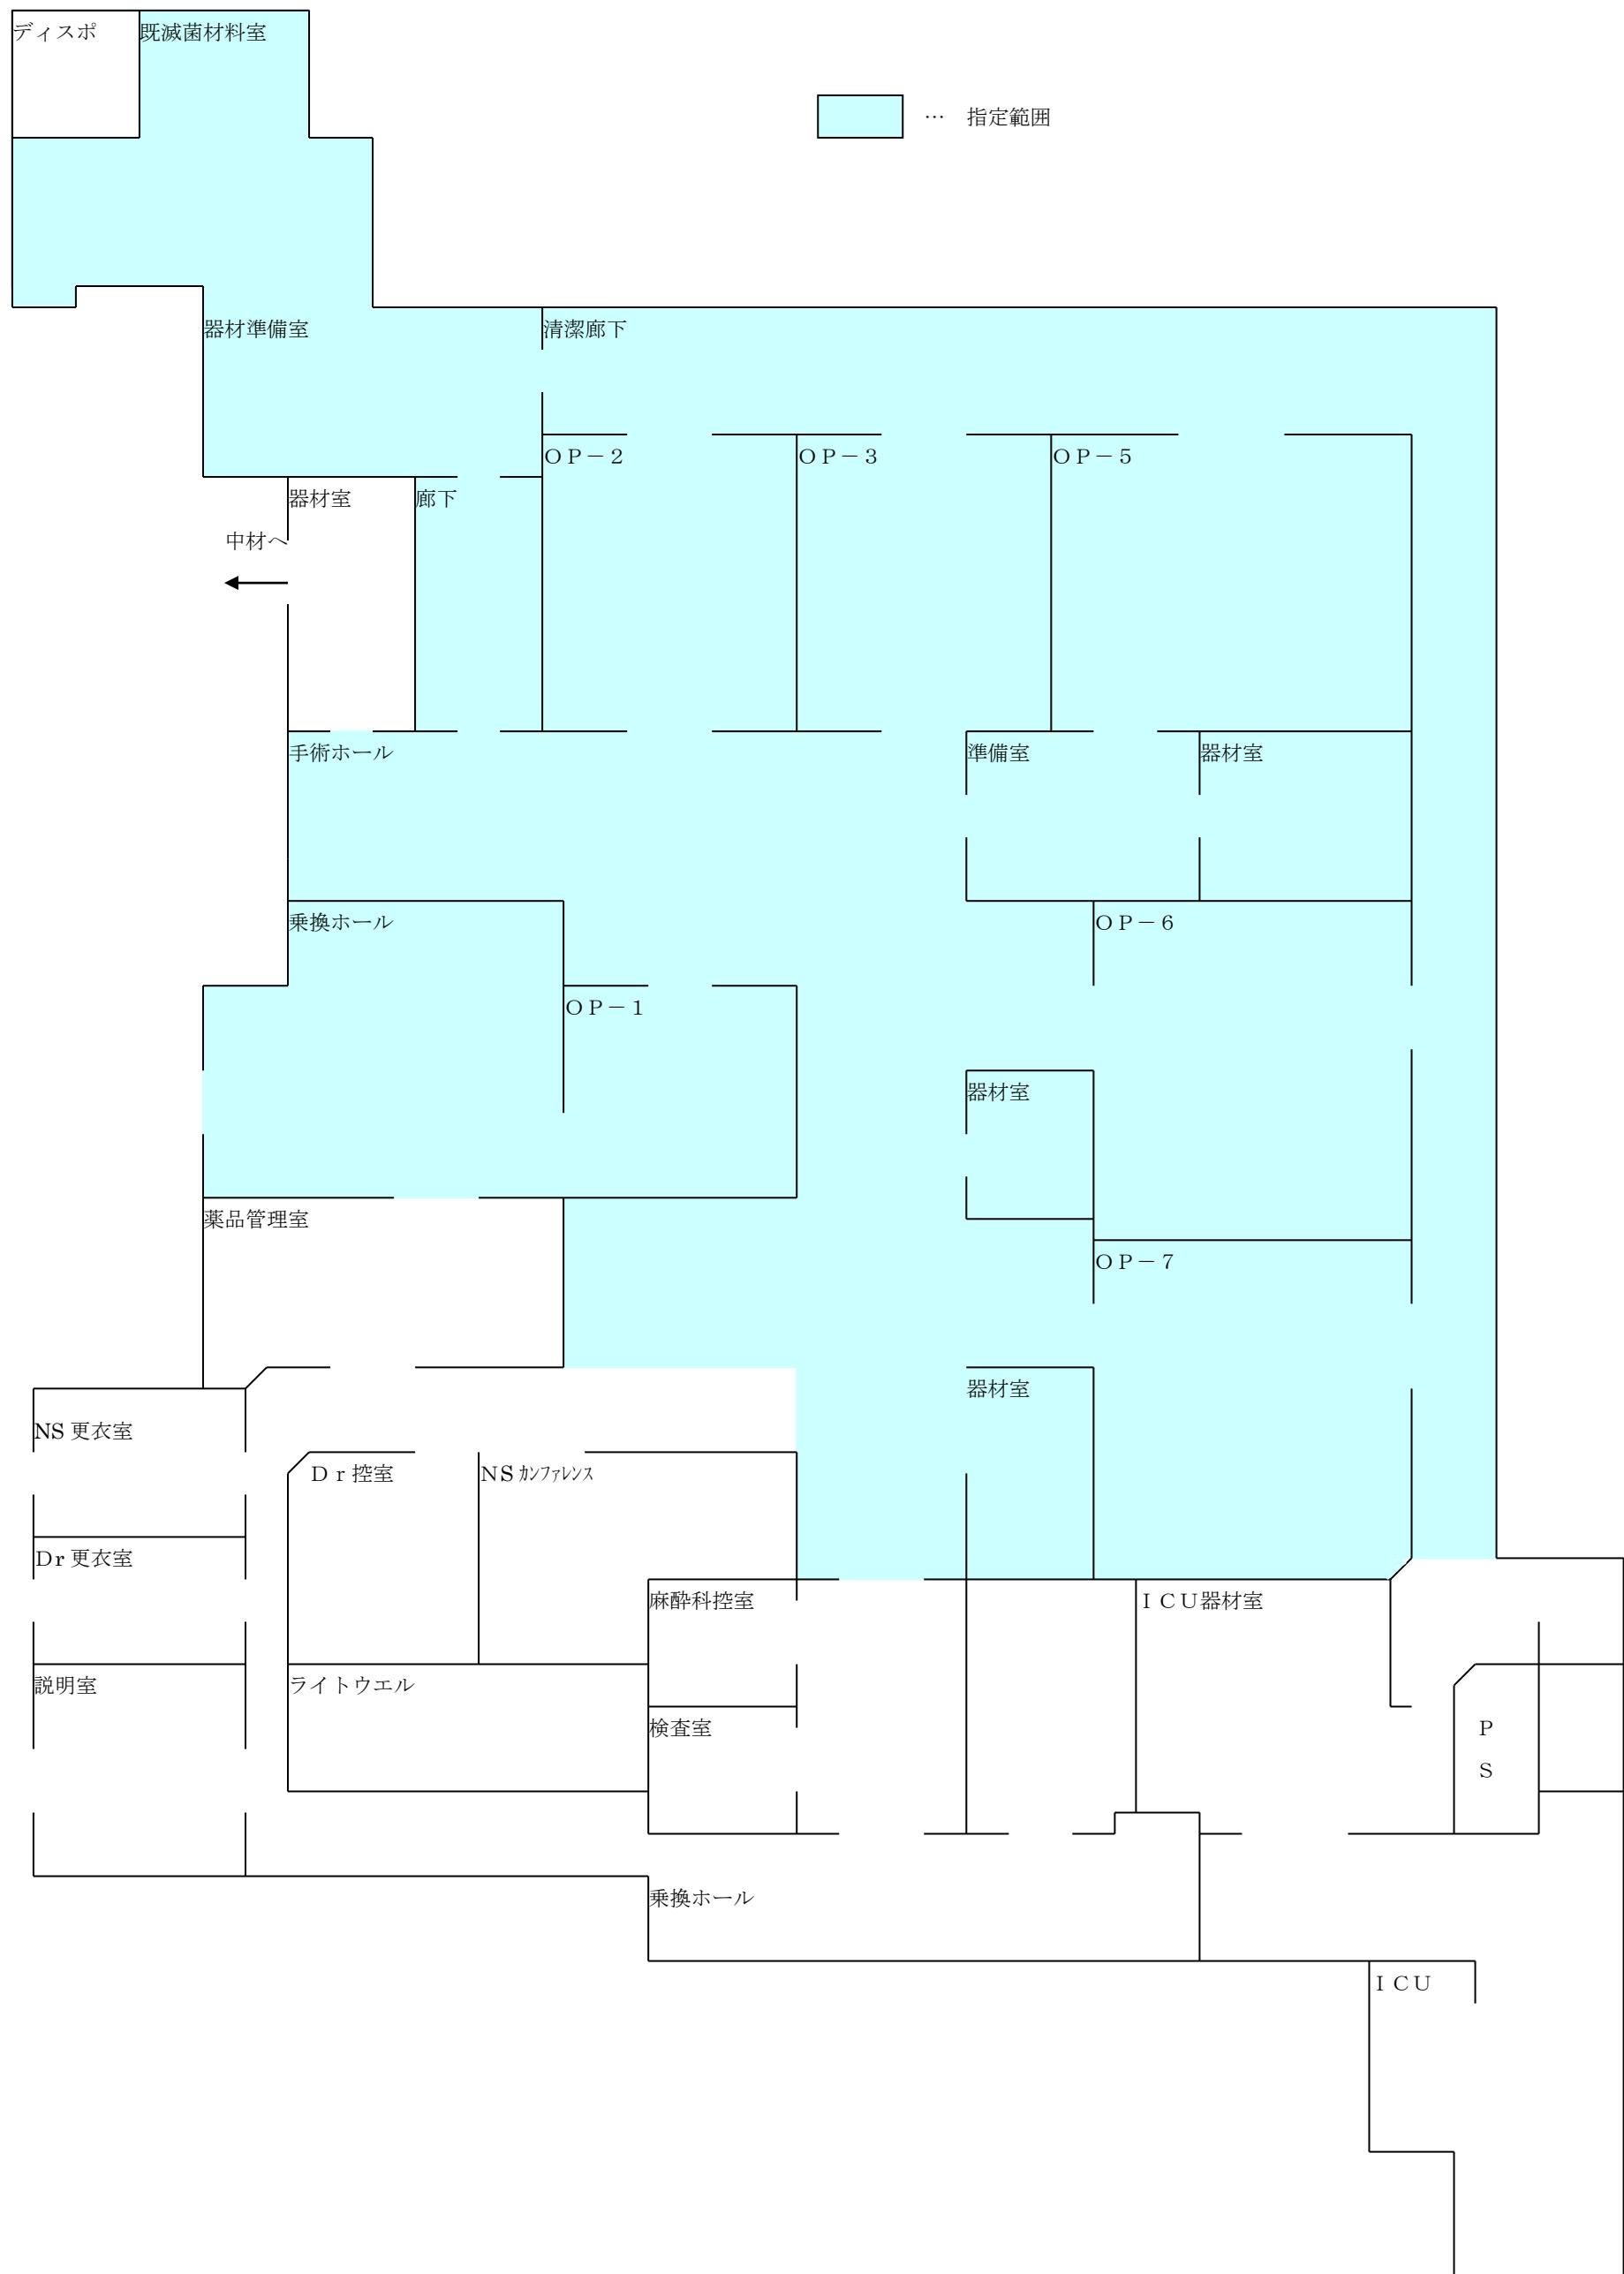


(別紙3) 手術室 表面付着菌測定点

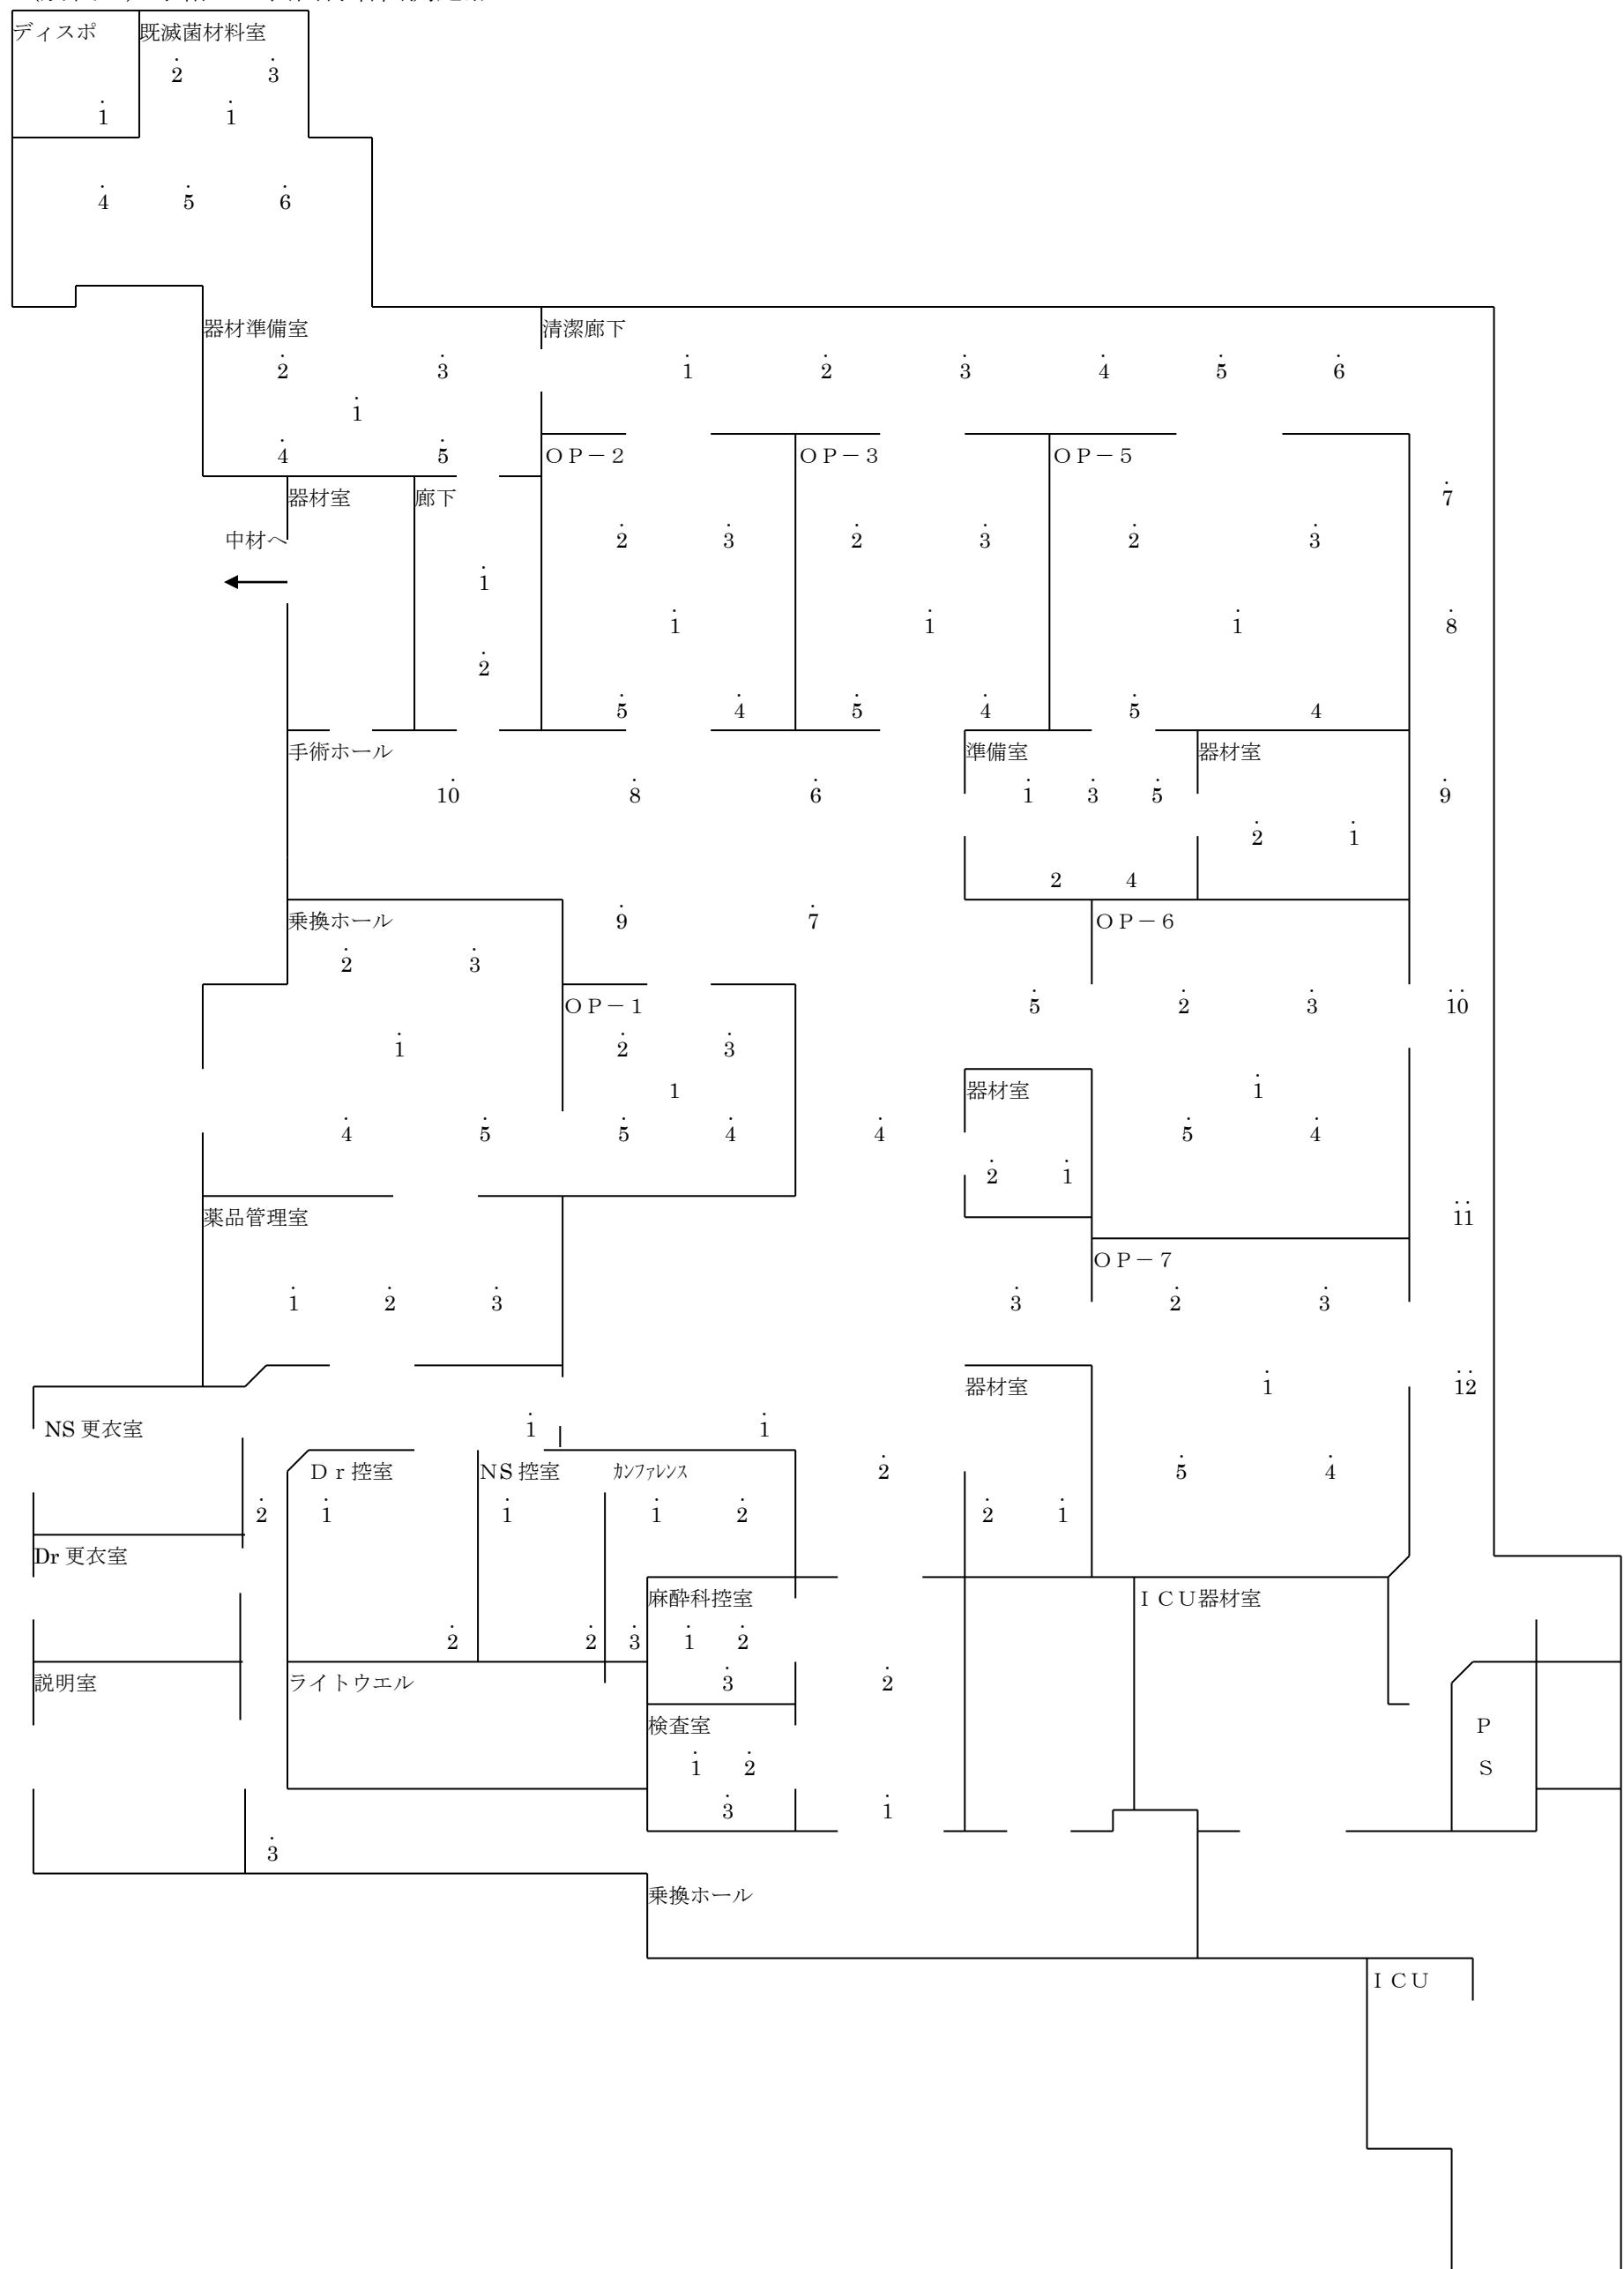


(別紙4) 手術室 空中浮遊塵挨数測定点

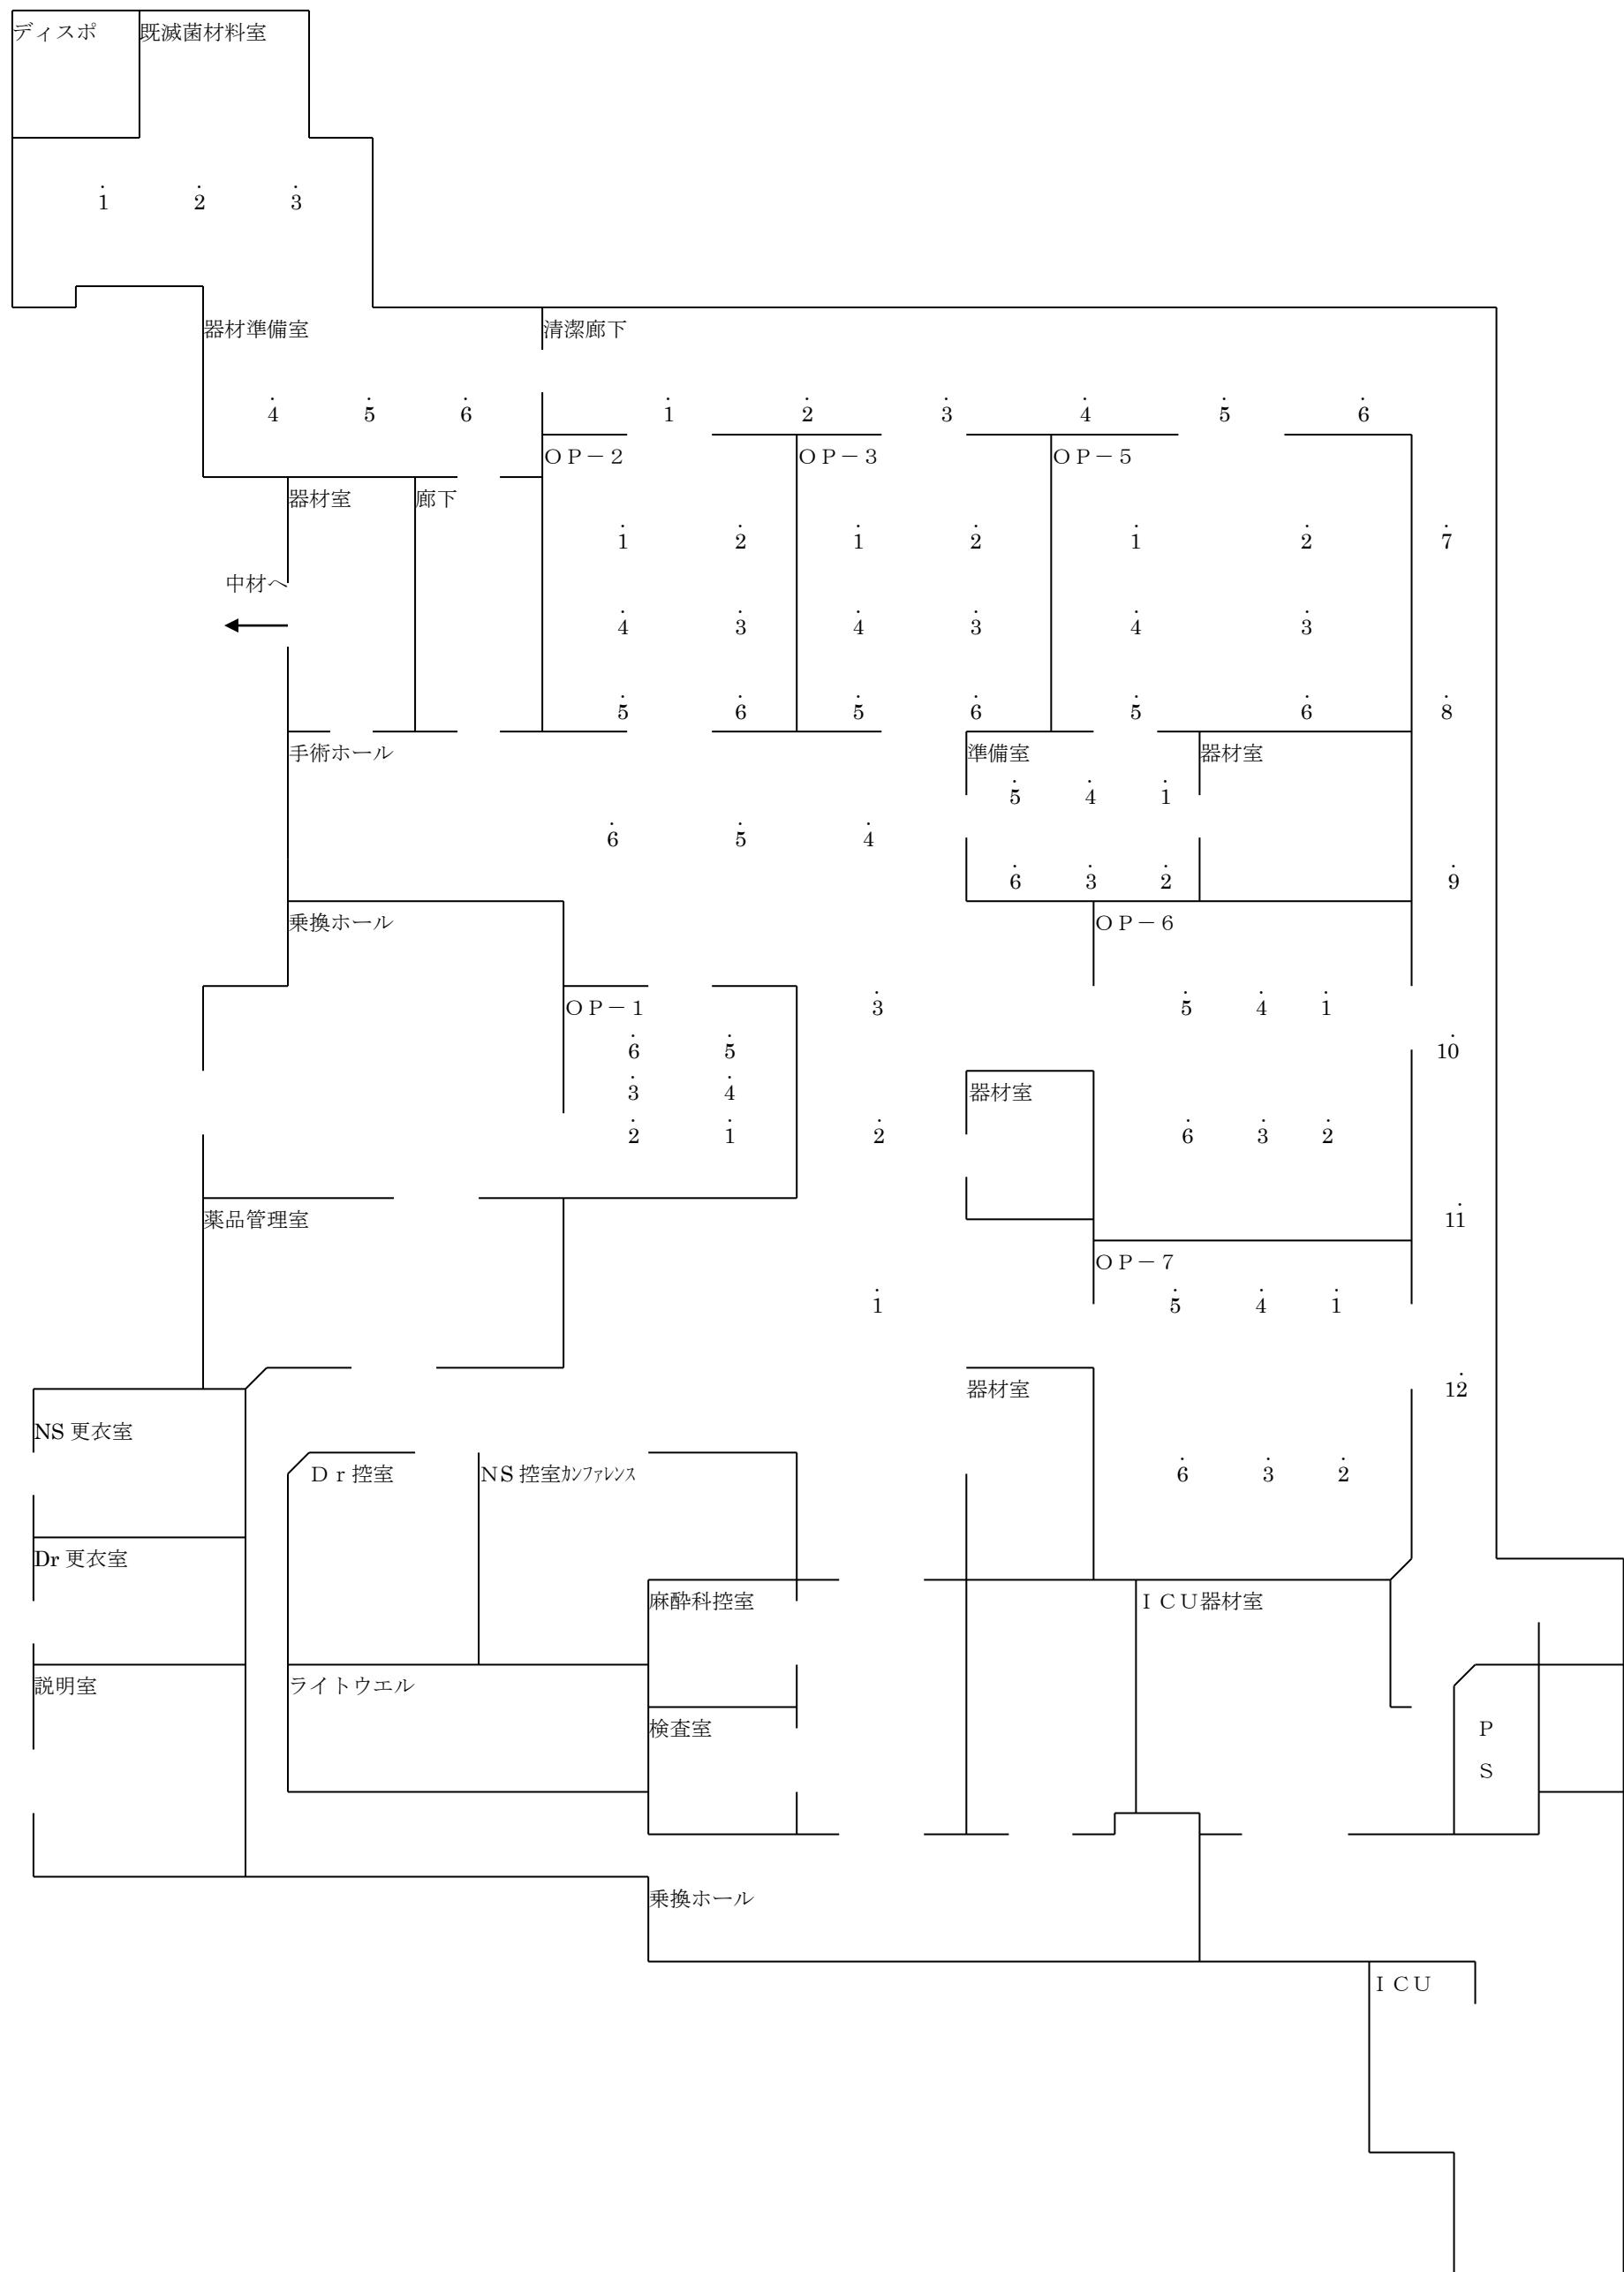


(別紙5) 手術室 空中浮遊菌測定点

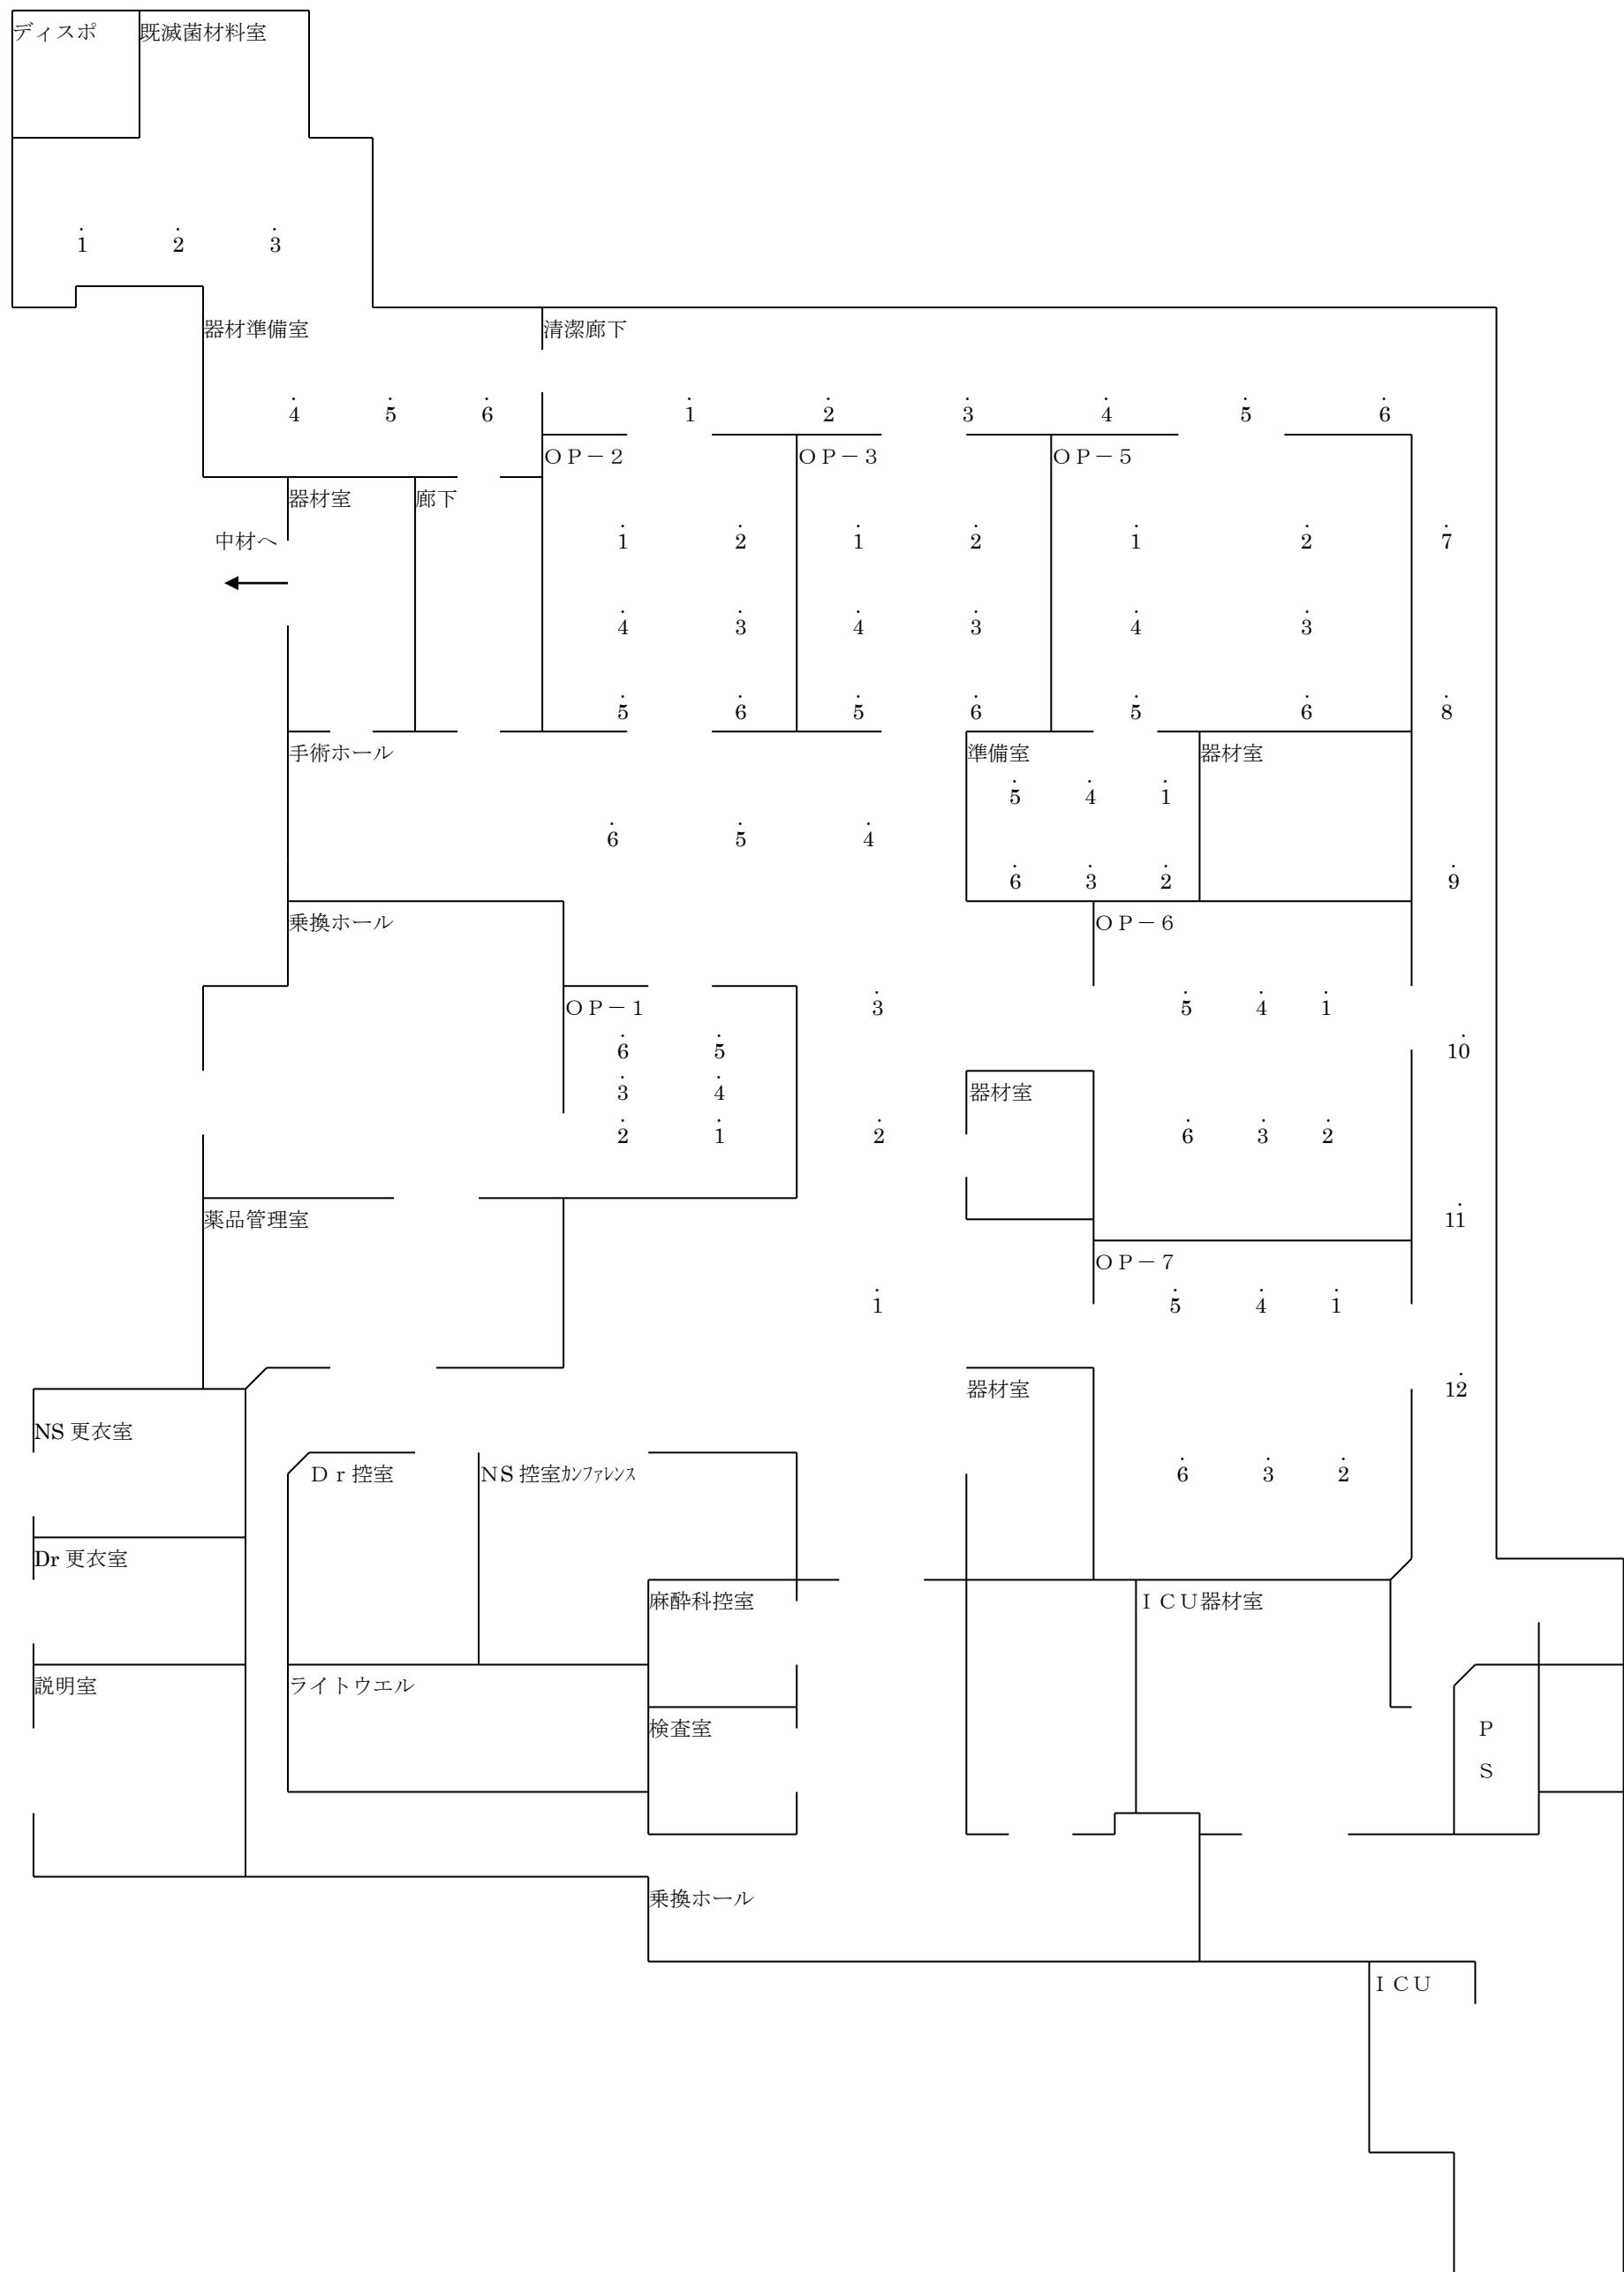


(別紙6) 手術室 風量風速・換気回数測定

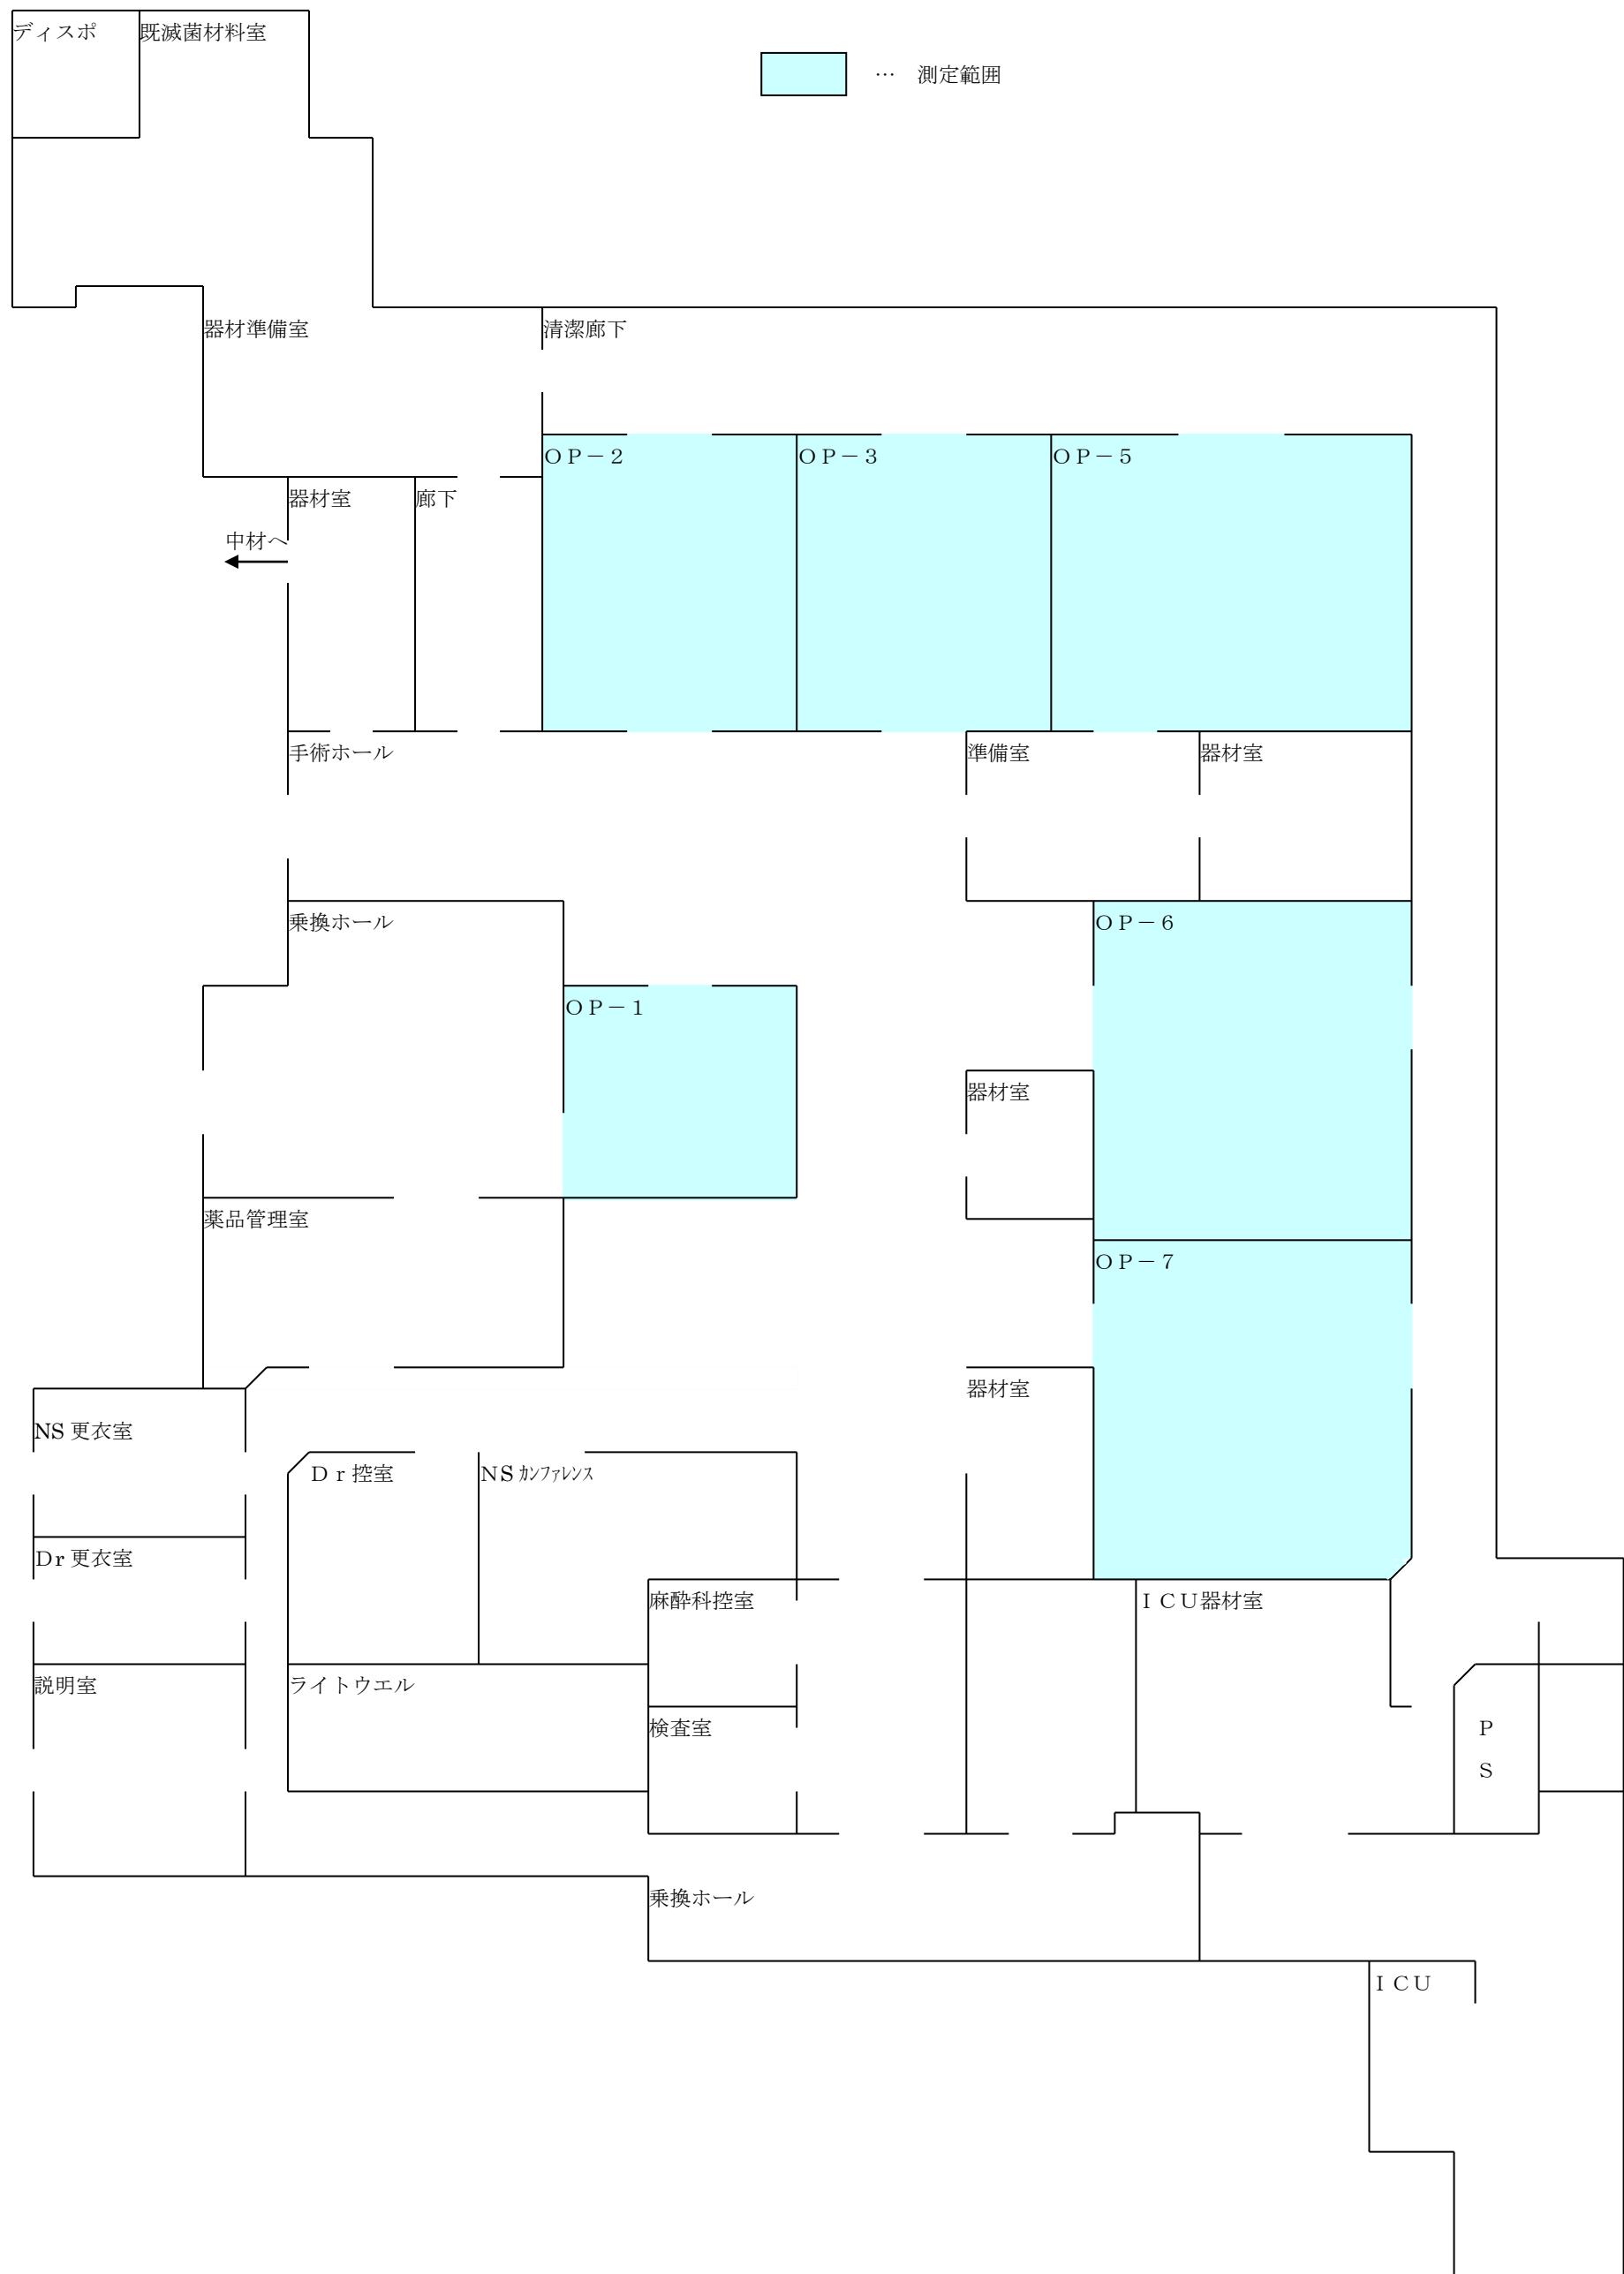


(別紙7) 手術室 壓力制御測定

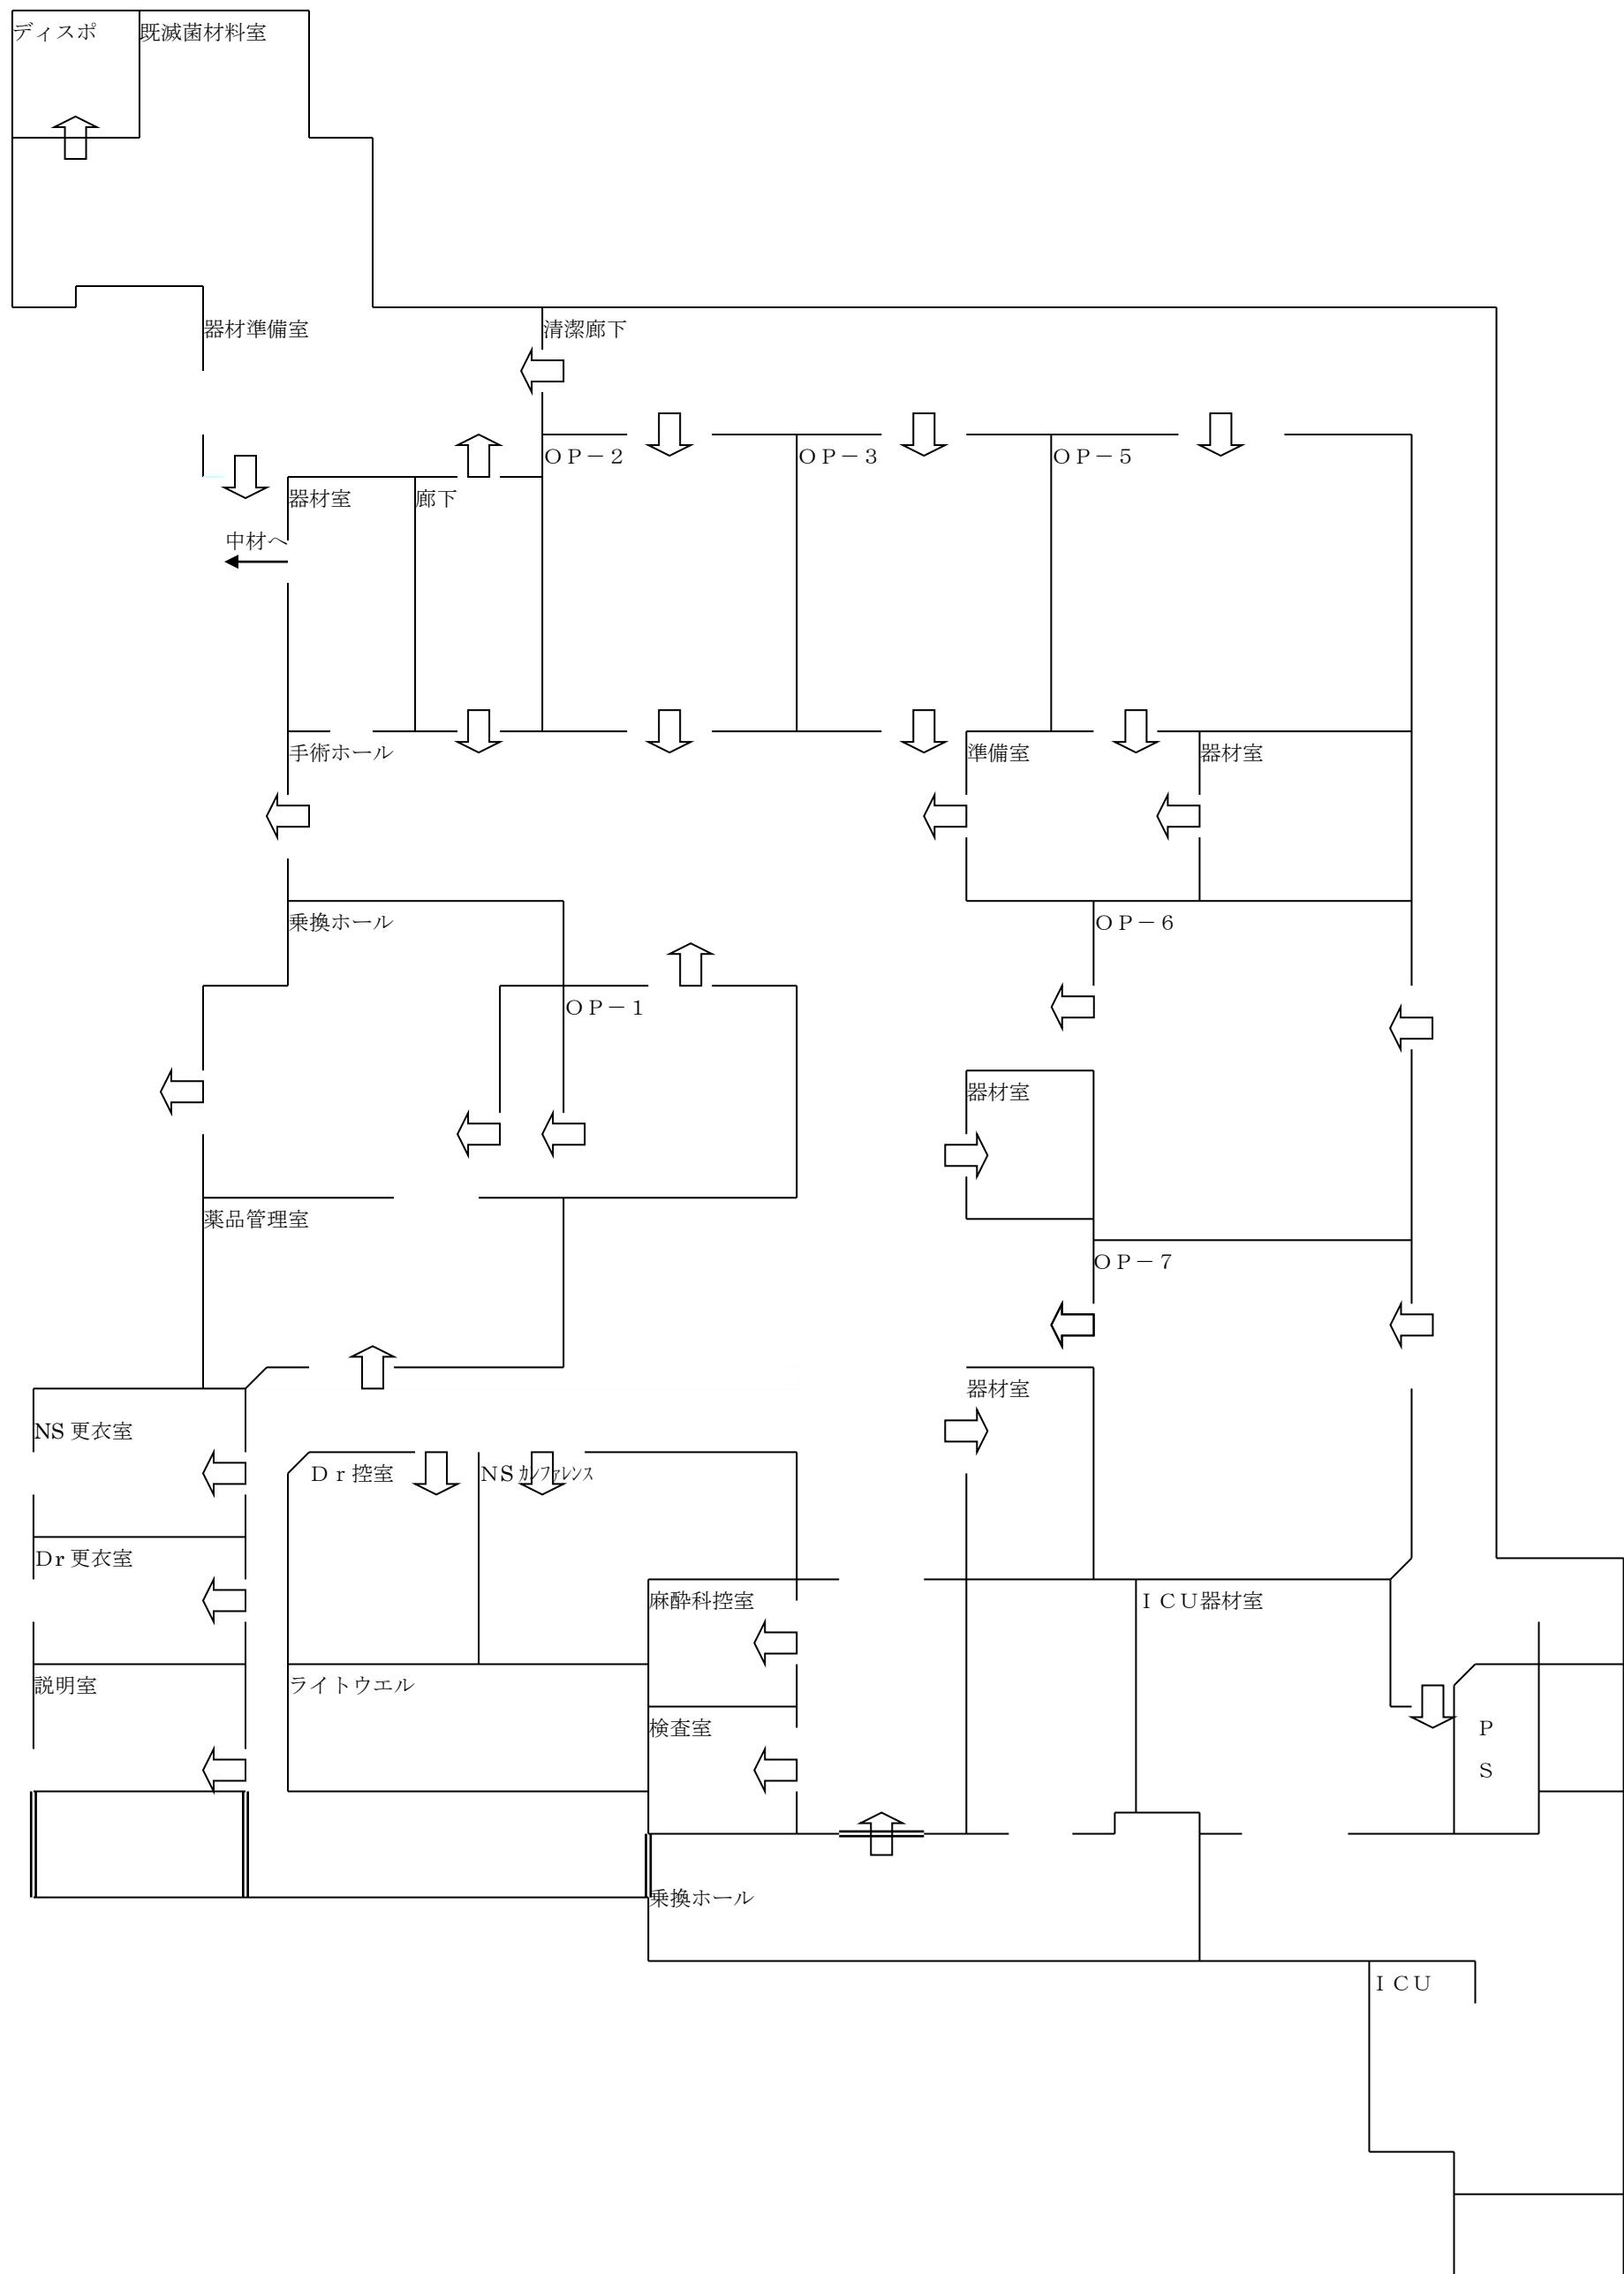


(別紙8) 手術室 温湿度測定

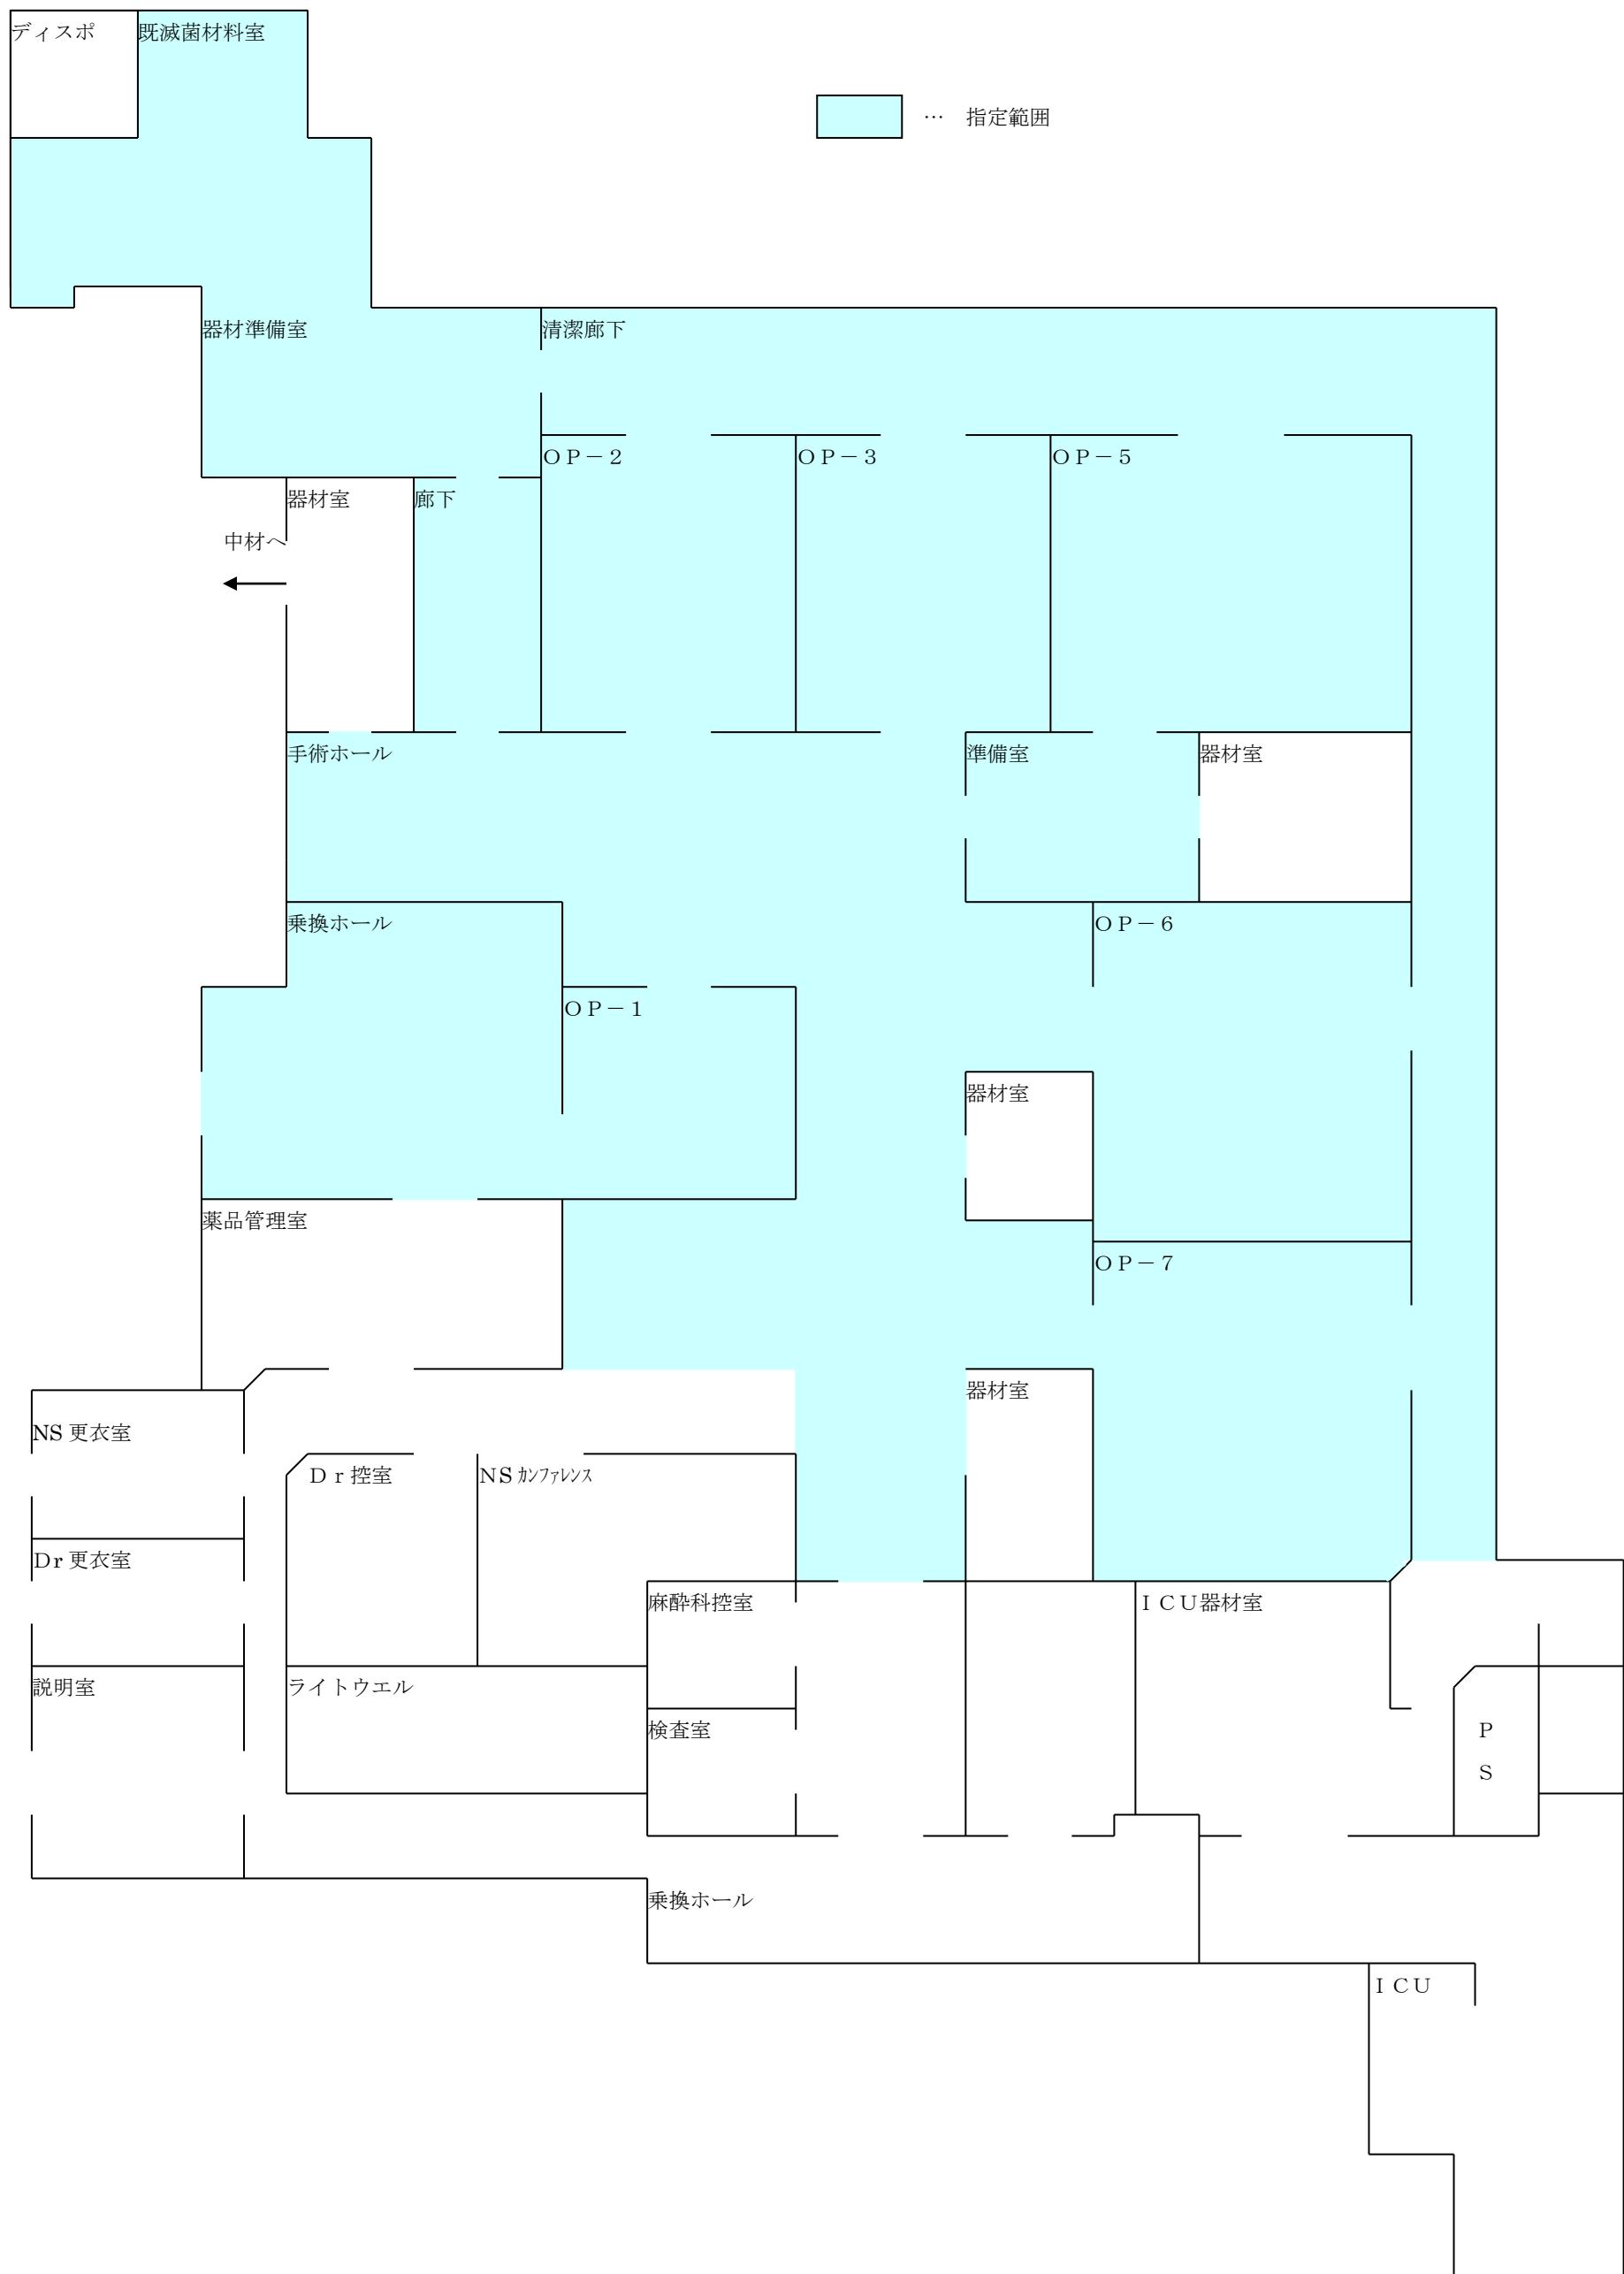


(別紙9) 手術室 HEPA フィルタ走査漏れ試験

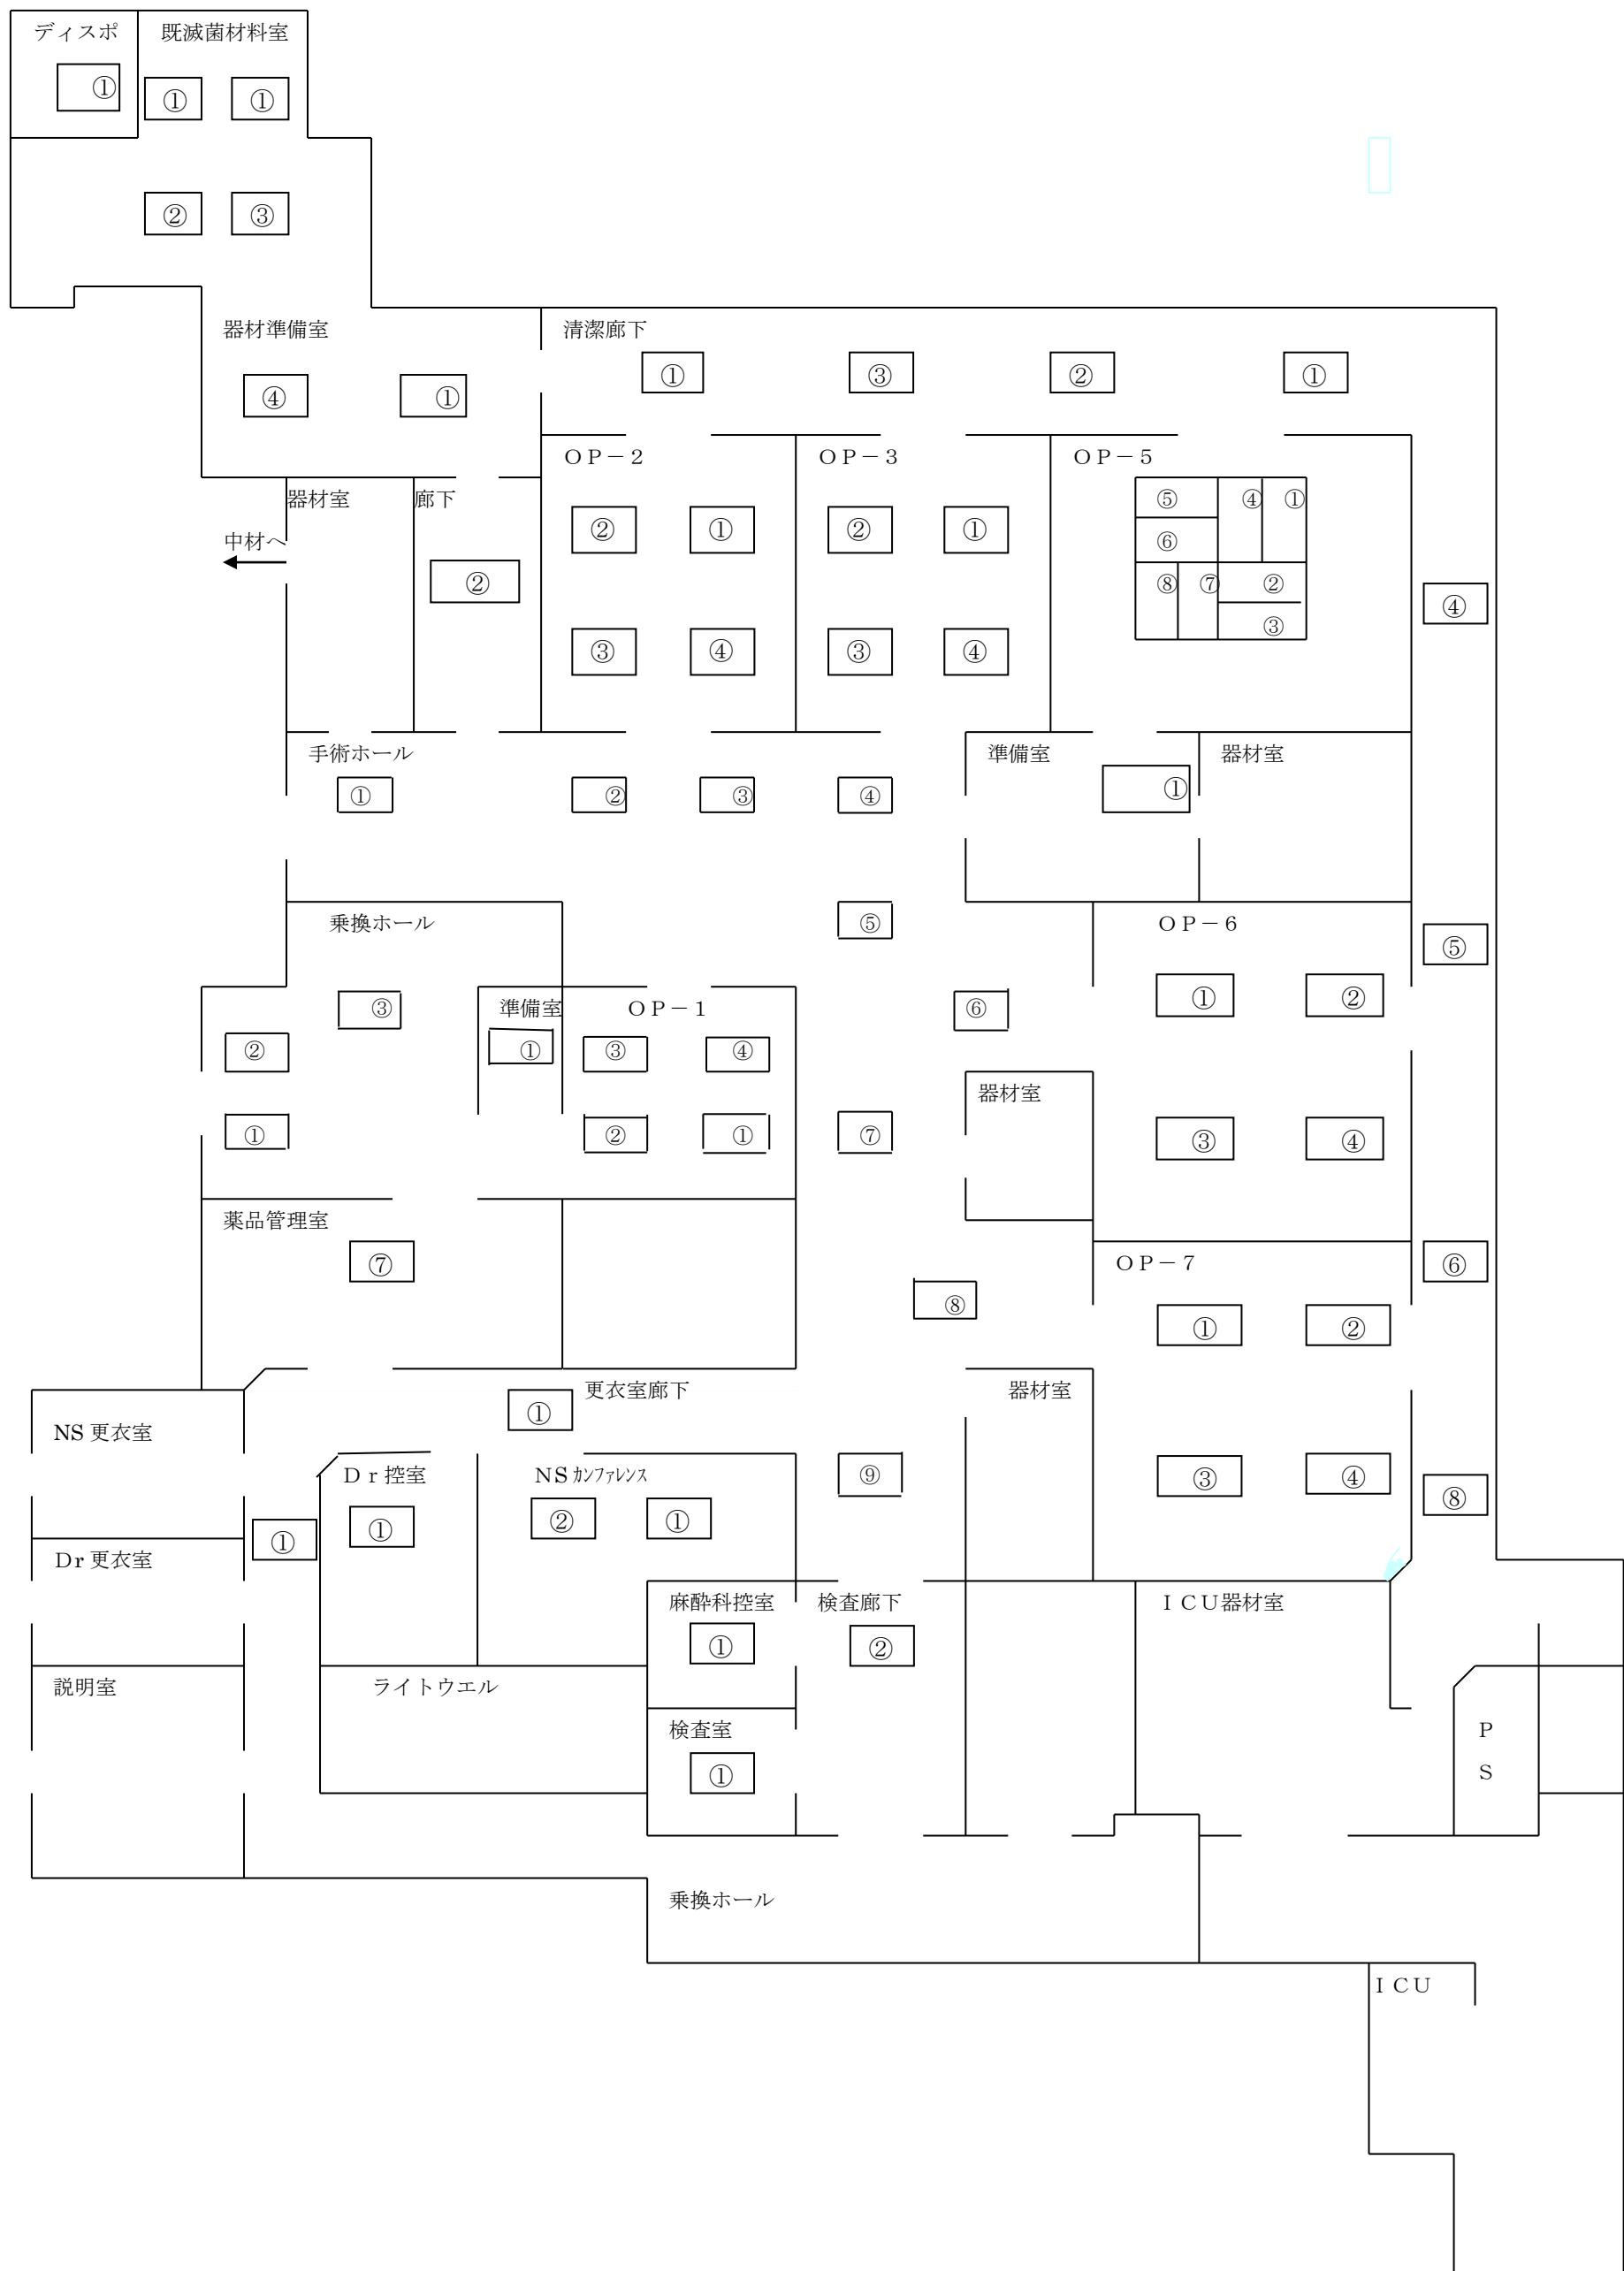

(別紙10) 手術室 清潔度回復能測定

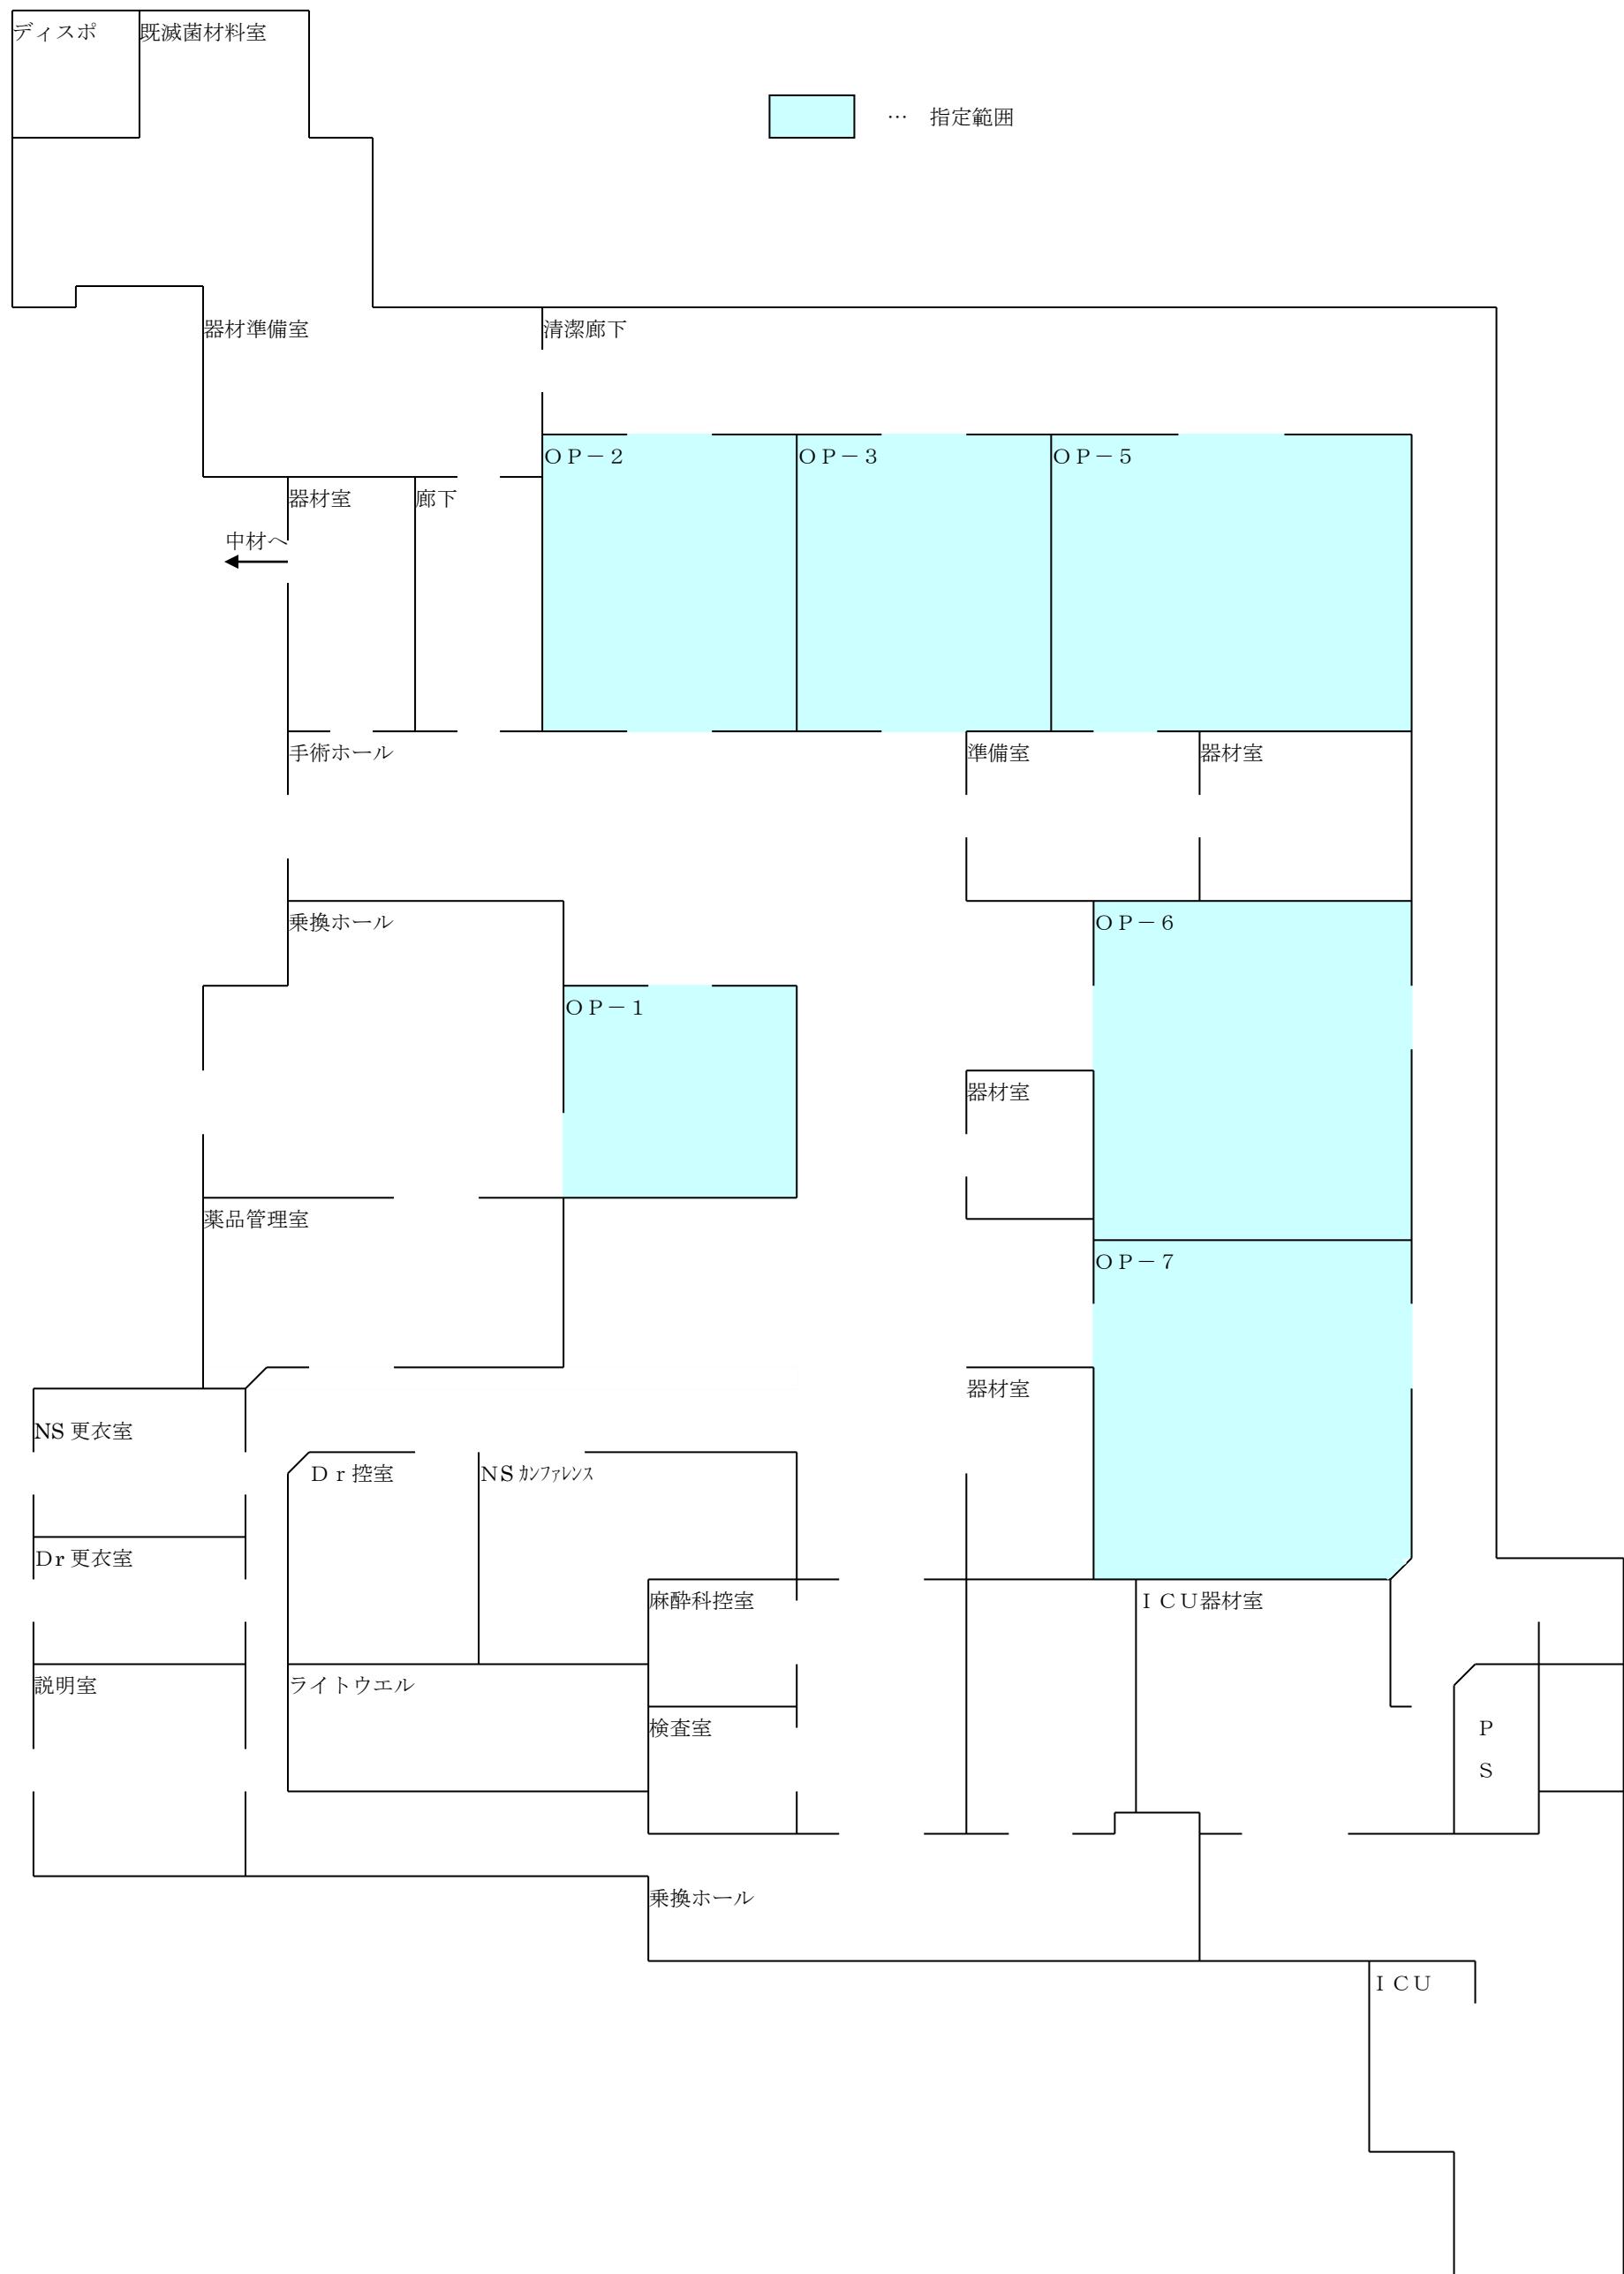

(別紙11) 手術室清掃範囲

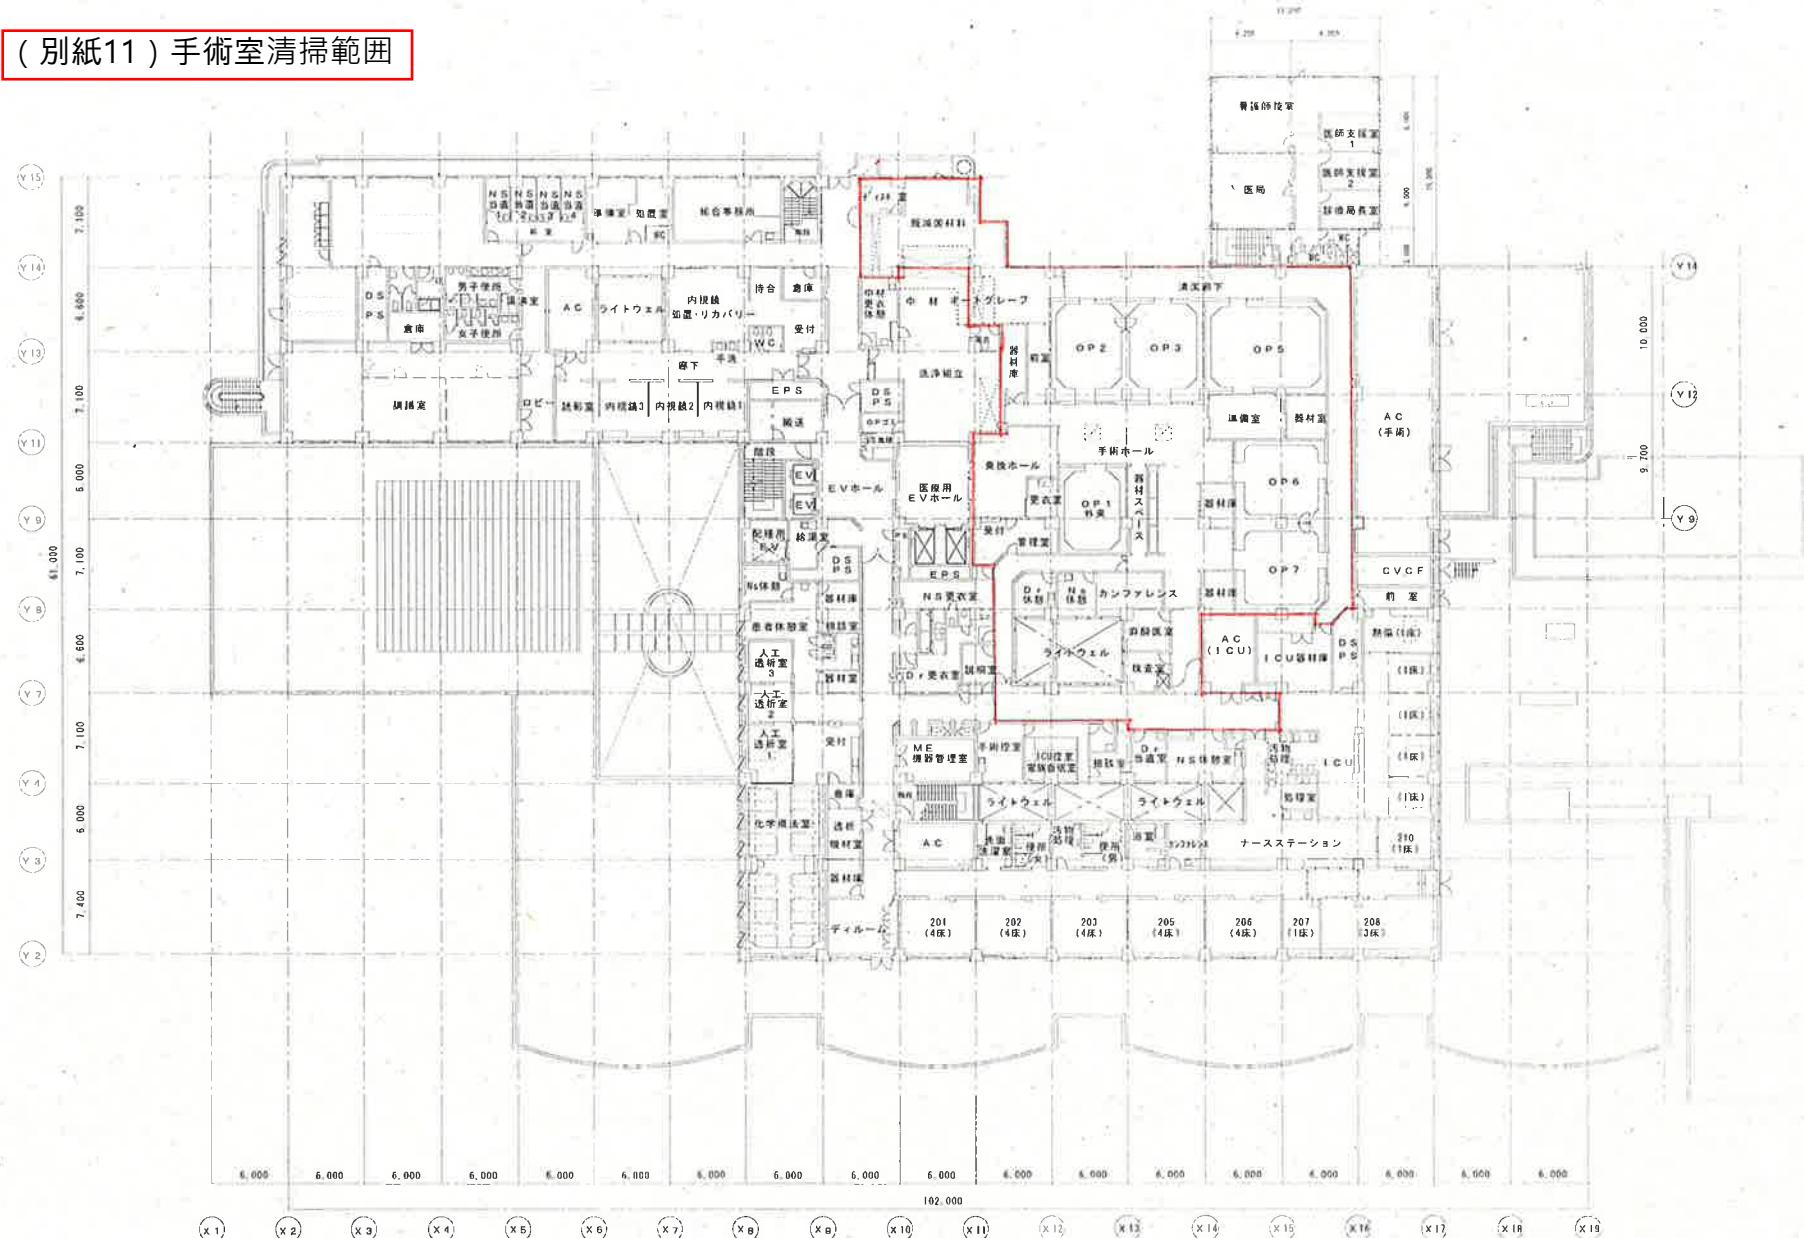

(別紙12) 手術室ワックス範囲

